

ЗАКАЗАТЬ



АНАЛИЗАТОР РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА МАРК-404

Руководство по эксплуатации

ВР16.00.000РЭ

ЕАС



г. Нижний Новгород 2021 г.

ООО «ВЗОР» будет благодарно за любые предложения и замечания, направленные на улучшение качества анализатора.

При возникновении любых затруднений при работе с анализатором обращайтесь к нам письменно или по телефону.

| | |
|------------------|------------------------------|
| почтовый адрес | 603000 г. Н.Новгород, а/я 80 |
| отдел маркетинга | (831) 282-98-00 |
| сервисный центр | (831) 282-98-02 |

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В анализаторе допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА | 4 |
| 1.1 Назначение изделия | 4 |
| 1.2 Основные параметры и размеры | 5 |
| 1.3 Технические характеристики | 7 |
| 1.4 Состав изделия | 9 |
| 1.5 Устройство и принцип работы..... | 9 |
| 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 19 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения | 19 |
| 2.2 Указание мер безопасности..... | 19 |
| 2.3 Подготовка анализатора к работе и проведение измерений | 20 |
| 2.4 Проверка технического состояния | 34 |
| 2.5 Возможные неисправности и методы их устранения | 34 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 37 |
| 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ..... | 42 |
| 5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 43 |
| 6 МАРКИРОВКА | 43 |
| 7 УПАКОВКА..... | 44 |
| 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ | 45 |
| 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 45 |
| 10 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ (КАЛИБРОВКЕ) | 46 |
| 11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 47 |
| 12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ..... | 48 |
| 13 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | 48 |
| 14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ | 48 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Методика поверки | 49 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Растворимость кислорода воздуха 100 % влажности в дистиллированной воде в зависимости от температуры..... | 65 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. Протокол обмена | 67 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Сведения об электролите | 71 |

Настоящий документ является совмещенным и включает разделы паспорта, а также методику поверки.

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения технических характеристик анализатора растворенного кислорода МАРК-404 (в дальнейшем – анализатор) и правил его эксплуатации.

При передаче анализатора в ремонт либо на поверку РЭ передается вместе с анализатором.

Анализатор соответствует требованиям ГОСТ 22018-84 «Анализаторы растворенного в воде кислорода амперометрические ГСП».

ВНИМАНИЕ: Конструкции датчика кислородного и блока преобразовательного содержат стекло. Их необходимо оберегать от ударов!

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Наименование и обозначение изделия

Анализатор растворенного кислорода МАРК-404

ТУ 26.51.53-009-39232169-2018

(идентичны ТУ 4215-009-39232169-2010).

1.1.2 Анализатор предназначен для измерения массовой концентрации растворенного в воде кислорода (КРК).

1.1.3 Область применения – на объектах экологии, рыбоводства, а также в других областях, где требуется контроль концентрации растворенного кислорода в поверхностных и сточных водах, в том числе мутных и окрашенных, с наличием органических загрязнителей.

1.1.4 Тип анализатора:

- с внешним поляризирующим напряжением;
- с шестью чувствительными элементами;
- непрерывного действия;
- однодиапазонный;
- с автоматической коррекцией температурной характеристики каждого чувствительного элемента;
- с выдачей результатов измерения на индикатор, по токовому выходу от 0 до 20 мА (с датчиками ДК-404) или от 4 до 20 мА (с датчиками ДК-404/1) и по порту RS-485;
- чувствительные элементы анализатора (датчики) – погружные.

1.2 Основные параметры и размеры

1.2.1 По устойчивости к климатическим воздействиям анализатор имеет группу исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.2.2 По устойчивости к механическим воздействиям анализатор имеет исполнение L1 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.2.3 По защищенности от воздействия окружающей среды анализатор имеет исполнение IP30 по ГОСТ 14254-2015.

1.2.4 По устойчивости к воздействию атмосферного давления анализатор имеет исполнение Р1 по ГОСТ Р 52931-2008 – атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.2.5 Параметры анализируемой воды:

- температура, °С от 0 до плюс 50;
- давление, МПа, не более 0,2;
- массовая концентрация солей, г/дм³ от 0 до 40;
- рН от 4 до 12.

1.2.6 Допустимые массовые концентрации неизмеряемых компонентов:

- растворенного аммиака, мг/дм³, не более 40,0;
- растворенного фенола, мг/дм³, не более 0,2.

1.2.7 Рабочие условия эксплуатации:

а) температура окружающего воздуха, °С:

- 1) блок преобразовательный от плюс 5 до плюс 50;
- 2) модуль токового выхода датчика кислородного
..... от минус 40 до плюс 50;

б) относительная влажность окружающего воздуха:

- 1) блок преобразовательный – 80 % при температуре плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- 2) модуль токового выхода датчика кислородного – 95 % при температуре плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

в) атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84,0 до 106,7(от 630 до 800).

1.2.8 Градуировка анализатора – по воздуху 100 % влажности.

1.2.9 Электрическое питание анализатора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В при частоте (50 ± 1) Гц.

Допускаемое отклонение напряжения питания от минус 15 до плюс 10 %.

1.2.10 Потребляемая мощность при номинальном значении напряжения питания, В·А, не более 25,0.

1.2.11 Сопротивление нагрузки каждого из токовых выходов, Ом, не более 500.

1.2.12 Время прогрева и установления теплового равновесия, ч, не более 0,5.

1.2.13 После установки запасных частей из комплекта ЗИП и градуировки анализатор сохраняет свои характеристики в пределах норм, установленных в технических условиях на анализатор.

1.2.14 Габаритные размеры и масса узлов анализатора соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование и обозначение узлов | | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Блок преобразовательный ВР16.01.000 | | 244×163×94 | 1,80 |
| Датчик кислородный ДК-404 ВР16.02.000 | Датчик ВР16.12.100 (без кабеля) | Ø20×223 | 0,35 |
| | Модуль токового выхода ВР16.02.200 | Ø17,6×108 | |
| Датчик кислородный ДК-404/1 ВР16.02.000-01 | Датчик ВР16.12.100 (без кабеля) | Ø20×223 | 0,35 |
| | Модуль токового выхода ВР16.02.200-01 | Ø17,6×108 | |

1.2.15 Условия транспортирования в транспортной таре по ГОСТ Р 52931-2008:

- температура, °С от минус 20 до плюс 50;
- относительная влажность воздуха при 35 °С, % 95 ± 0,3;
- синусоидальная вибрация с частотой 5-35 Гц, амплитудой смещения 0,35 мм в направлении, обозначенном на упаковке манипуляционным знаком «Верх».

1.2.16 Требования к надежности

1.2.16.1 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 20000.

1.2.16.2 Среднее время восстановления работоспособности, ч, не более...2.

1.2.16.3 Средний срок службы анализаторов, лет, не менее 10.

1.2.17 Требования безопасности

1.2.17.1 Анализатор по способу защиты от поражения электрическим током относится к классу защиты 1.

1.2.17.2 Электрическая изоляция между цепями питания анализатора и его корпусом должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока со среднеквадратичным значением 1500 В и частотой (50 ± 1) Гц в нормальных условиях применения.

1.2.17.3 Электрическое сопротивление изоляции цепей питания анализатора между штырями вилки и корпусом, МОм, не менее:

- при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С 40;
- при температуре окружающего воздуха 50 °С 10;
- при относительной влажности окружающего воздуха 95 % 2.

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Диапазон измерения массовой концентрации растворенного кислорода (в дальнейшем КРК) при температуре анализируемой среды $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, мг/дм^3 от 0 до 10,00.

Верхний предел диапазона измерения КРК зависит от температуры анализируемой среды и приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| t °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| КРК, мг/дм ³ | 17,45 | 15,29 | 13,48 | 12,10 | 10,00 | 9,85 | 8,98 | 8,30 | 7,69 | 7,12 | 6,59 |

1.3.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК при температуре анализируемой среды $(20,0 \pm 0,2)\text{ }^{\circ}\text{C}$ и температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)\text{ }^{\circ}\text{C}$, мг/дм^3 $\pm (0,05 + 0,04C)$, где C – здесь и далее по тексту – измеряемое значение КРК.

1.3.3 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК, обусловленной изменением температуры анализируемой среды, на каждые $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ от нормальной $(20,0 \pm 0,2)\text{ }^{\circ}\text{C}$ в пределах всего рабочего диапазона температур от 0 до плюс $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, мг/дм^3 ... $\pm 0,012C$.

1.3.4 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые $\pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ от нормальной $(20 \pm 5)\text{ }^{\circ}\text{C}$ в пределах всего рабочего диапазона температур блока преобразовательного от плюс 5 до плюс $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, мг/дм^3 $\pm 0,01C$.

1.3.5 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК при избыточном давлении анализируемой среды до 0,2 МПа, мг/дм^3 $\pm 0,1C$.

1.3.6 Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК при температуре анализируемой среды, совпадающей с температурой градуировки и находящейся в диапазоне от плюс 5 до плюс $35\text{ }^{\circ}\text{C}$, и температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)\text{ }^{\circ}\text{C}$, мг/дм^3 $\pm (0,05 + 0,04C)$.

1.3.7 Диапазон токового выхода, мА:

- при работе с датчиками ДК-404 от 0 до 20;
- при работе с датчиками ДК-404/1 от 4 до 20.

Функция преобразования измеренного значения C , мг/дм^3 , в выходной ток блока преобразовательного $I_{\text{вых}}$, мА, при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)\text{ }^{\circ}\text{C}$ на нагрузке, не превышающей 500 Ом, соответствует выражениям:

- для токового выхода 0-20 мА (датчик кислородный ДК-404):

$$I_{\text{вых}} = \beta \cdot C; \quad (1.1)$$

– для токового выхода 4-20 мА (датчик кислородный ДК-404/1):

$$I_{\text{вых}} = 4 + 16 \cdot \frac{\beta \cdot C}{20}, \quad (1.2)$$

где $\beta = 1 \frac{\text{мА}}{\text{мг/дм}^3}$ в отградуированном датчике кислородном.

1.3.8 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования КРК в выходной ток анализатора при температуре анализируемой среды $(20,0 \pm 0,2) \text{ } ^\circ\text{C}$ и температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) \text{ } ^\circ\text{C}$, мА..... $\pm (0,05 + 0,035I_{\text{вых}})$,

где $I_{\text{вых}}$ – здесь и далее по тексту – измеряемое значение выходного тока анализатора.

1.3.9 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования КРК в выходной ток анализатора, обусловленной изменением температуры анализируемой среды, на каждые $\pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от нормальной $(20,0 \pm 0,2) \text{ } ^\circ\text{C}$ в пределах всего рабочего диапазона температур от 0 до плюс $50 \text{ } ^\circ\text{C}$, мА $\pm 0,012I_{\text{вых}}$.

1.3.10 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при преобразовании КРК в выходной ток анализатора, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые $\pm 10 \text{ } ^\circ\text{C}$ от нормальной $(20 \pm 5) \text{ } ^\circ\text{C}$ в пределах всего рабочего диапазона температур модуля токового выхода от минус 40 до плюс $50 \text{ } ^\circ\text{C}$, мА $\pm (0,030 + 0,007I_{\text{вых}})$.

1.3.11 Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при преобразовании КРК в выходной ток анализатора при температуре анализируемой среды, совпадающей с температурой градуировки и находящейся в диапазоне от плюс 5 до плюс $35 \text{ } ^\circ\text{C}$, и температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) \text{ } ^\circ\text{C}$, мА $\pm (0,05 + 0,035I_{\text{вых}})$.

1.3.12 Нестабильность показаний анализатора за время непрерывной работы 8 ч, мг/дм³, не более $\pm (0,025 + 0,02C)$.

1.3.13 Нестабильность выходного тока анализатора за время непрерывной работы 8 ч, мА, не более $\pm (0,025 + 0,017I_{\text{вых}})$.

1.3.14 Предел допускаемого значения времени установления показаний (выходного тока) анализатора при измерении КРК $t_{0,9}$, мин, не более 1.

1.3.15 Предел допускаемого значения времени установления показаний (выходного тока) анализатора при измерении КРК t_y , мин, не более 2.

1.3.16 Диапазон регулировки КРК (отношение максимального значения КРК к минимальному) при градуировке, не менее 3.

1.3.17 При подключении к персональному компьютеру (ПК) анализатор осуществляет обмен информацией с ПК по интерфейсу RS-485.

1.4 Состав изделия

В состав анализатора входит блок преобразовательный и датчики кислородные ДК-404 или ДК-404/1 в количестве до шести штук.

1.5 Устройство и принцип работы

1.5.1 Общие сведения об анализаторе

Анализатор – шестиканальный, микропроцессорный, с преобразованием массовой концентрации растворенного кислорода в выходной ток, а также с ручным последовательным опросом каждого из каналов для вывода измеренного значения массовой концентрации растворенного кислорода (КРК) на индикатор.

Программное обеспечение (ПО) анализатора предназначено для обработки команд, задаваемых нажатием кнопок управления и вывода измеренного значения КРК на индикатор. При подключении анализатора к персональному компьютеру (ПК) ПО осуществляет обмен информацией с ПК по интерфейсу RS-485.

Может быть использован при создании распределенных систем мониторинга водных объектов.

Датчик кислородный включает в себя датчик с преобразователем КРК в напряжение, с независимой автоматической термокомпенсацией каждого датчика, и модуль токового выхода, преобразующий напряжение в выходной ток датчика кислородного.

Анализатор имеет шесть выходов с выходными унифицированными сигналами постоянного тока от 0 до 20 мА либо от 4 до 20 мА. Диапазон токового выхода каждого канала определяется типом подключенного датчика:

- от 0 до 20 мА для датчика кислородного ДК-404;
- от 4 до 20 мА для датчика кислородного ДК-404/1.

Диапазон токового выхода при выводе значения КРК на индикатор выбирается пользователем через опцию анализатора в соответствии с типом подключенного датчика отдельно для каждого из шести каналов.

Датчик и модуль токового выхода соединяются кабелем длиной 5 м (по заказу до 20 м).

Модуль токового выхода соединяется с блоком преобразовательным вставкой кабельной ВК404.L длиной до 1000 м. Через вставку кабельную ВК404.L поступает питание от блока преобразовательного на датчик кислородный, а выходной ток датчика кислородного, зависящий от КРК в анализируемой среде, поступает на блок преобразовательный.

1.5.2 Принцип измерения кислорода

При измерении КРК используется амперометрический датчик, по принципу работы совпадающий с полярографической ячейкой закрытого типа.

Электроды погружены в раствор электролита, который отделен от анализируемой среды мембраной, проницаемой для кислорода, но непроницаемой для жидкости и паров воды. Кислород из анализируемой среды диффундирует через мембрану в тонкий слой электролита между катодом и мембраной и вступает в электрохимическую реакцию на поверхности катода, который поляризуется внешним напряжением, приложенным между электродами. При этом в датчике вырабатывается сигнал постоянного тока, который при фиксированной температуре пропорционален КРК в анализируемой среде.

Выходной сигнал датчика поступает на модуль токового выхода.


Выходной токовый сигнал с датчика кислородного, поступающий на вход блока преобразовательного, подается на выходной разъем анализатора.

1.5.3 Составные части анализатора

1.5.3.1 Блок преобразовательный

На *передней панели* блока преобразовательного в соответствии с рисунком 1.1 находятся:

- кнопки « \leftarrow » и « \rightarrow » для переключения каналов индикации КРК в режиме измерения; для перехода в режим просмотра и изменения параметров анализатора и для изменения параметров анализатора;
- 7-сегментный индикатор для вывода на экран показаний КРК включенного канала индикации, индикации в режиме просмотра и изменения параметров анализатора и сообщений об ошибках;
- светодиодные индикаторы «1», «2», «3», «4», «5», «6», «ГРАДУИР» включенного канала индикации КРК.

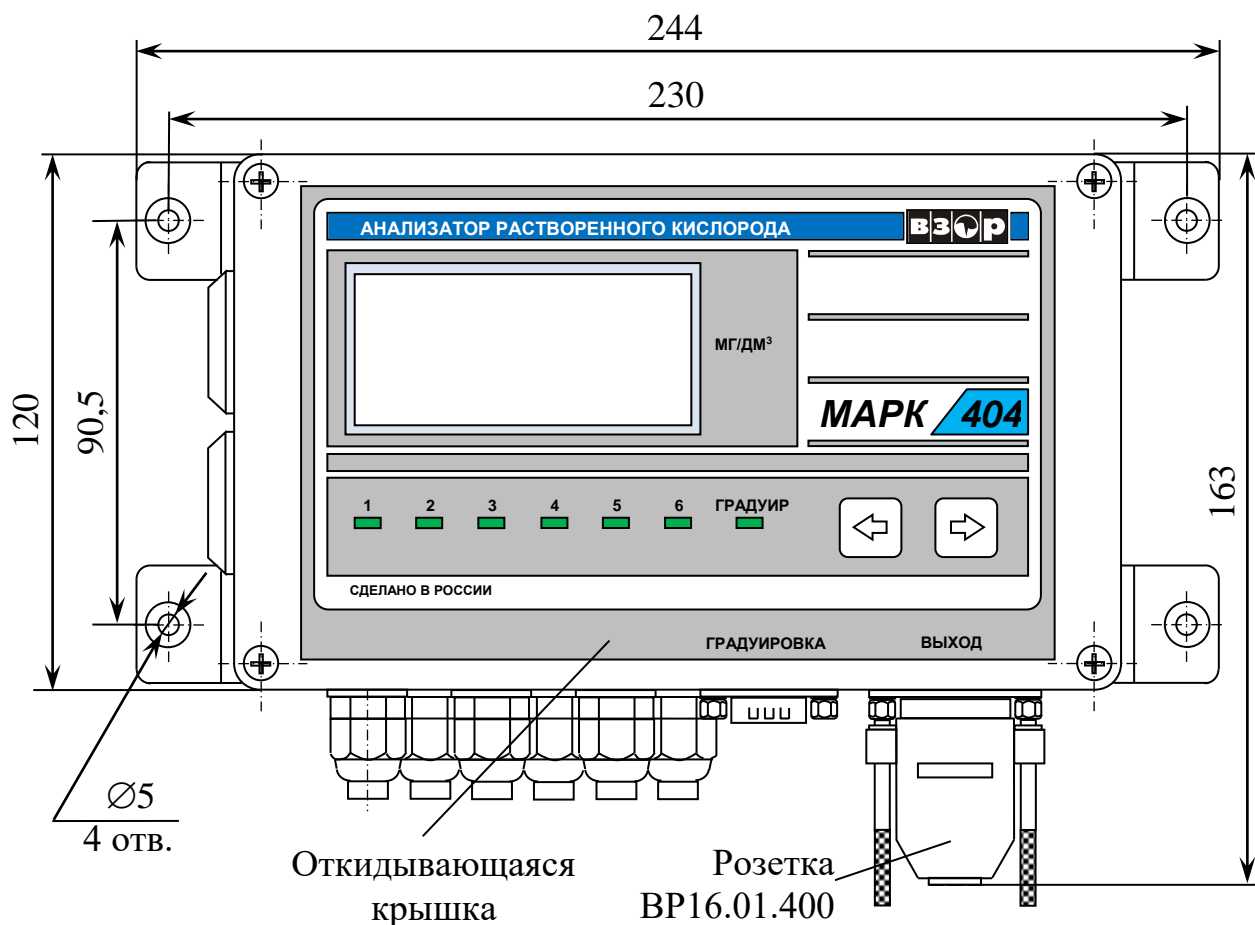

Вид снизу

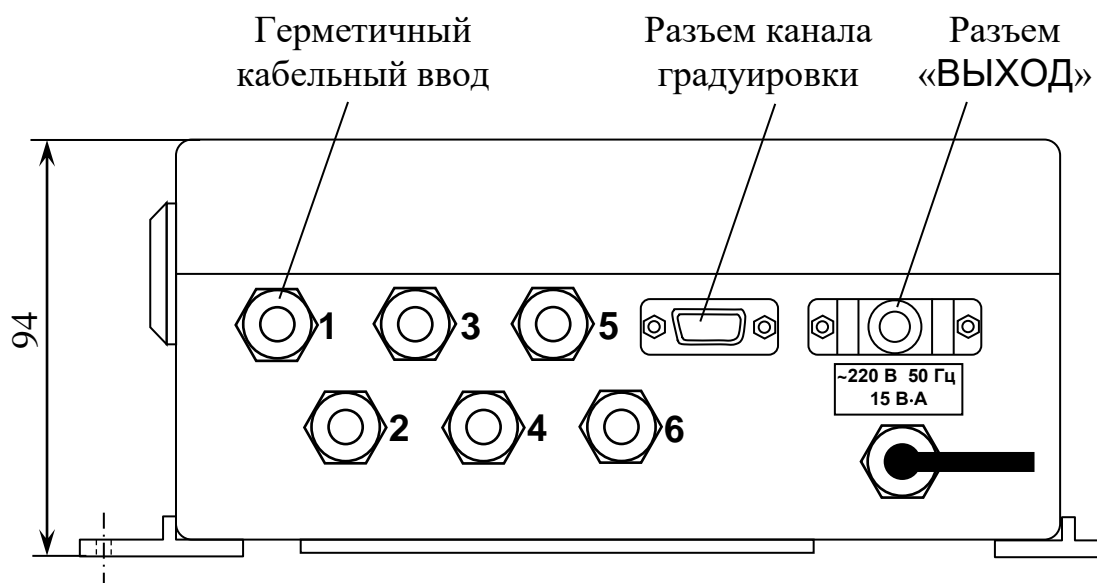


Рисунок 1.1 – Анализатор растворенного кислорода МАРК-404

На *нижней панели* корпуса блока преобразовательного находятся:

- ввод сетевого кабеля;
 - разъем канала градуировки «**ГРАДУИР**»;
 - шесть герметичных кабельных вводов для герметизации подсоединения кабельных вставок к клеммникам, расположенным под откидывающейся крышкой (маркировка токовых выходов показана условно).
 - разъем «**ВЫХОД**» для подключения внешнего регистрирующего устройства с помощью розетки ВР16.01.400. На контакты разъема выдаются токовые сигналы 0-20 мА либо 4-20 мА со всех шести каналов измерения КРК.
- С канала градуировки токовый сигнал не выдается.

Примечание – Анализатор поставляется с установленной розеткой ВР16.01.400. Заготовкой для розетки ВР16.01.400 служит розетка DB15-F.

1.5.3.2 Датчик кислородный ДК-404, ДК-404/1

Датчик кислородный ДК-404 (ДК-404/1) состоит из датчика и модуля токового выхода. Основные детали датчика кислородного показаны на рисунке 1.2.

Основными функциональными элементами *датчика* являются электроды, представляющие собой платиновый катод и серебряный анод.

Платиновый катод впаян в торец стеклянной трубки, которая установлена во внутренний корпус датчика. На поверхность платинового катода нанесено специальное покрытие. Серебряный анод размещен на внутреннем корпусе датчика.

Электронная плата датчика закрыта корпусом из нержавеющей стали.

Узел мембранный М404 (далее – узел мембранный), состоящий из корпуса и мембраны, зафиксированной внутри с помощью винта и кольца уплотнительного, заполняется электролитом и наворачивается на внутренний корпус датчика.

Модуль токового выхода соединяется с датчиком кабелем. Кожух из нержавеющей стали защищает электронную плату модуля токового выхода. Шлиц градуировки расположен на торцевой поверхности модуля токового выхода.

Разъем на модуле токового выхода соединяется с разъемом на *вставке кабельной ВК404.L*. Второй конец вставки кабельной ВК404.L пропущен через один из шести герметичных кабельных вводов на корпусе блока преобразовательного и подключен к соответствующему *клеммнику* под откидывающейся крышкой блока преобразовательного.

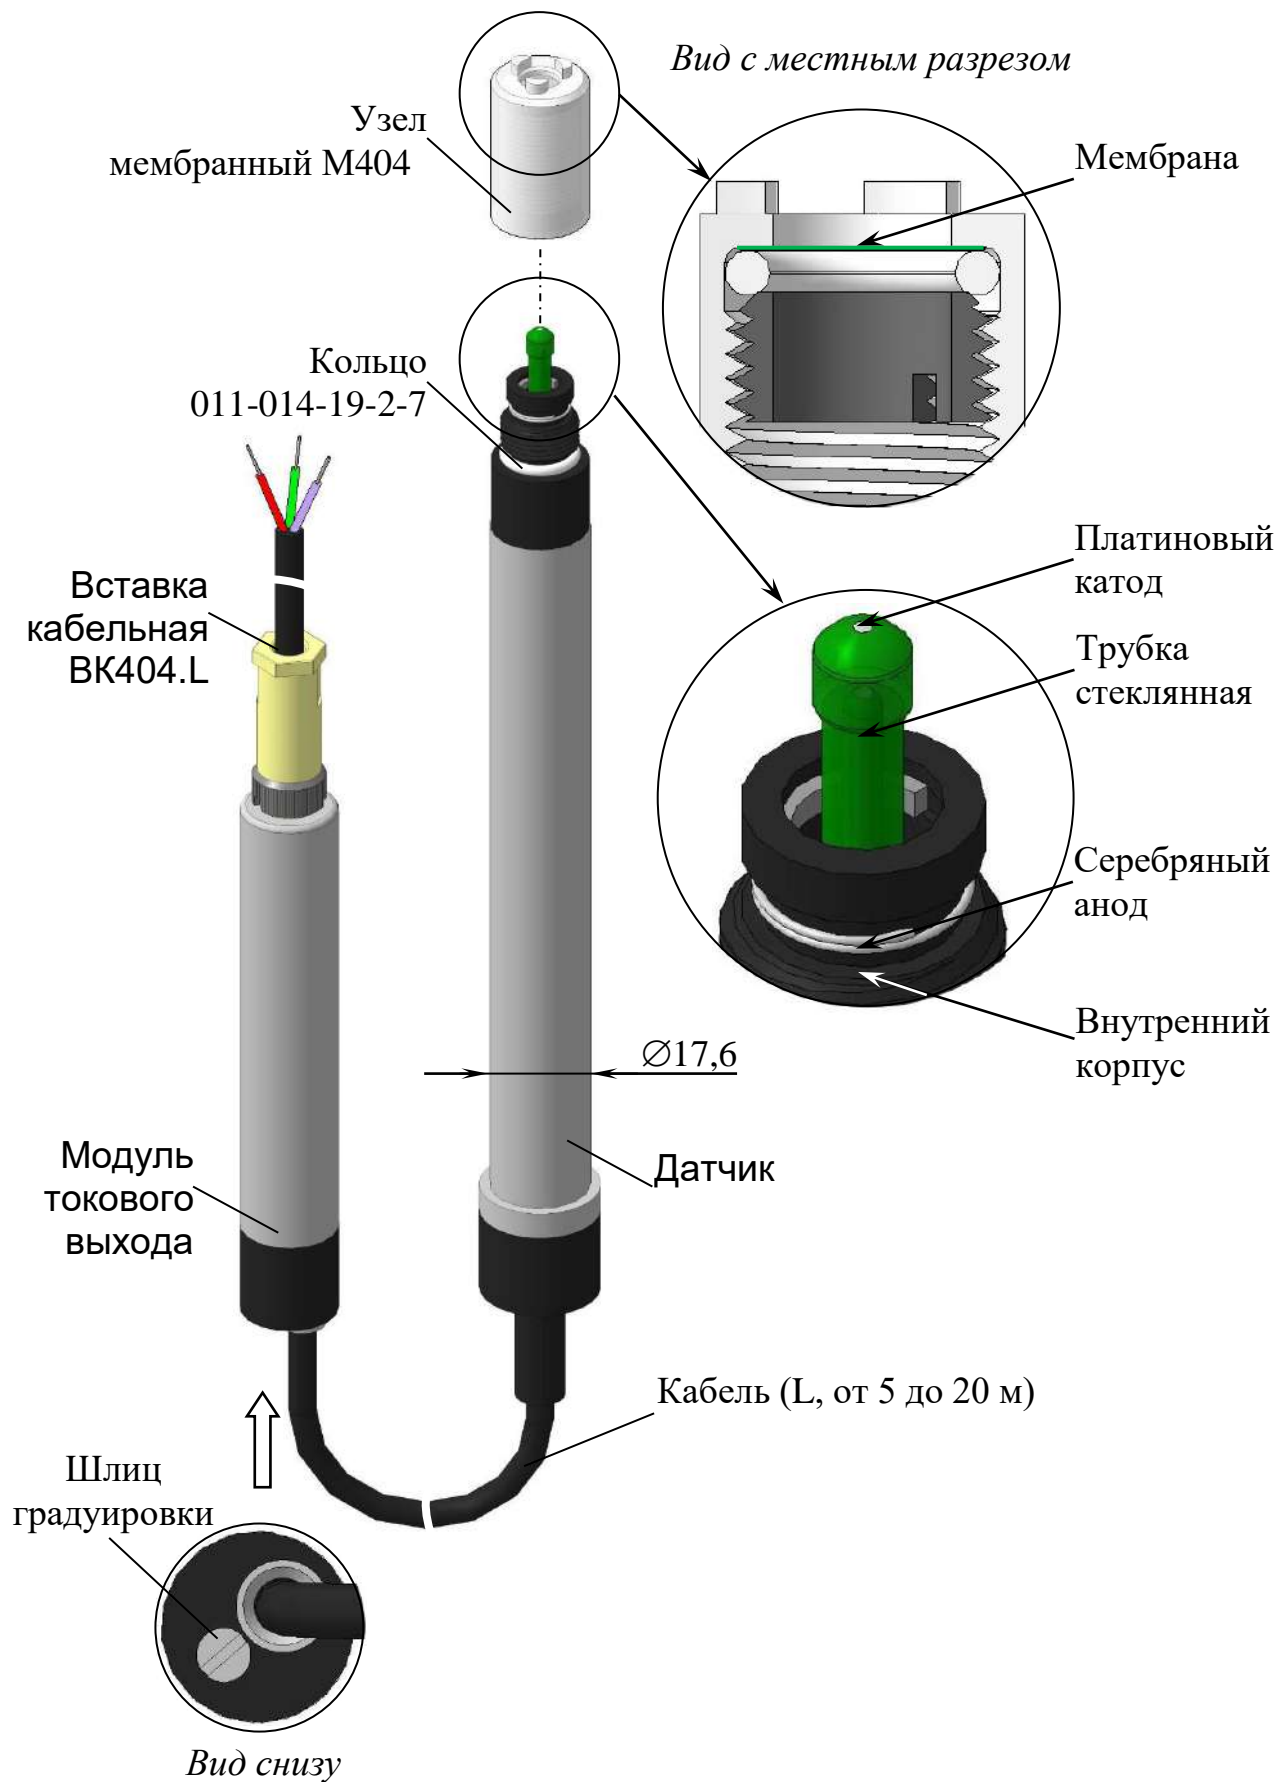


Рисунок 1.2 – Датчик кислородный ДК-404 (ДК-404/1)

1.5.4 Режимы просмотра и изменения параметров анализатора

1.5.4.1 Общие указания

В анализаторе во всех каналах кроме режима индикации КРК предусмотрены режимы просмотра и изменения параметров:

- режим просмотра и изменения типа токового выхода;
- режим просмотра и изменения времени усреднения;
- режим просмотра и изменения сетевого адреса;
- режим просмотра версии ПО на индикаторе блока преобразовательного;
- режим просмотра и изменения скорости обмена блока преобразовательного с ПК.

Примечание – В любом режиме анализатора на разъем «**ВЫХОД**» выдается измеренное значение по всем каналам, к которым подключены датчики кислородные, кроме канала «**ГРАДУИРОВКА**».

Переход в эти режимы осуществляется длинным (более 1 с) нажатием кнопок « \leftarrow » или « \Rightarrow », сопровождающимся двойным звуковым сигналом.

Длинным нажатием кнопки « \Rightarrow » анализатор переводится из режима индикации КРК в режим просмотра типа токового выхода.

Длинным нажатием кнопки « \leftarrow » анализатор переводится:

- из режима индикации КРК в режим просмотра времени усреднения показаний;
- из режима просмотра времени усреднения показаний в режим просмотра сетевого адреса;
- из режима просмотра сетевого адреса в режим просмотра версии ПО;
- из режима просмотра версии ПО в режим просмотра скорости обмена блока преобразовательного с ПК.

Короткое нажатие кнопок « \leftarrow » или « \Rightarrow » в режиме просмотра параметра, сопровождающееся одинарным звуковым сигналом, переводит анализатор из режима просмотра в режим изменения параметра, при этом изменяемое значение становится мигающим. Затем коротким нажатием этих кнопок производится изменение либо выбор нужного параметра.

Длинное нажатие кнопки « \Rightarrow » после установки нужного значения параметра переводит анализатор обратно в режим просмотра параметра. Измененное значение перестает быть мигающим. Еще одно длинное нажатие переводит анализатор из режима просмотра параметра в режим индикации КРК.

Длинное нажатие кнопки « \Rightarrow » после установки нужного типа токового выхода либо просмотра версии ПО переводит анализатор сразу в режим индикации КРК.

1.5.4.2 Режим просмотра и изменения типа токового выхода

Коротким нажатием кнопок «←» или «→» выбрать канал индикации. После длинного нажатия кнопки «→» появится один из экранов в соответствии с рисунками 1.3-1.5.

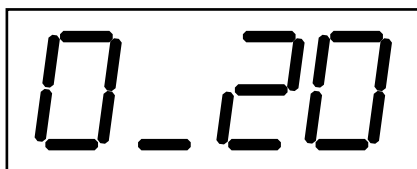


Рисунок 1.3

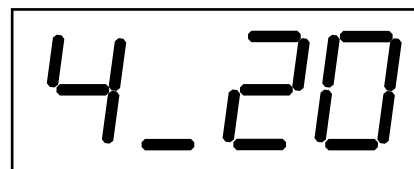


Рисунок 1.4

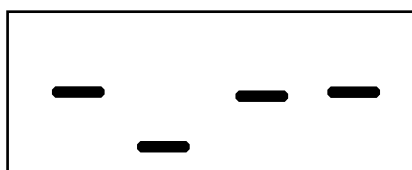


Рисунок 1.5

Выбрать тип токового выхода в соответствии с рисунками 1.3 или 1.4. Для отключения индикации КРК в выбранном канале выбрать экран в соответствии с рисунком 1.5.

При переходе в режим индикации КРК появится экран, например, в соответствии с рисунком 1.6.



Рисунок 1.6

Если индикация КРК канала отключена, при переходе в режим индикации КРК появится экран в соответствии с рисунком 1.7.

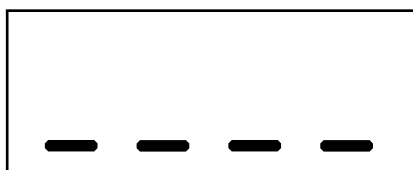


Рисунок 1.7

1.5.4.3 Режим просмотра и изменения времени усреднения

Для получения более стабильных показаний в анализаторе предусмотрено усреднение показаний за время от 0 до 9 мин. Время усреднения устанавливается одновременно для всех каналов анализатора.

На канал «ГРАДУИР» опция установки времени усреднения не распространяется.

Экран просмотра и изменения времени усреднения – в соответствии с рисунком 1.8.

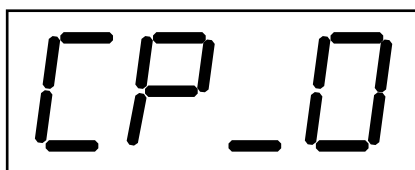


Рисунок 1.8

Установить нужное значение времени усреднения.

1.5.4.4 Просмотр и изменение сетевого адреса

Сетевой адрес служит для идентификации данного анализатора при работе нескольких приборов, объединенных в сеть, по интерфейсу RS-485. Может принимать значения от «00» до «255». При работе вне сети сетевой адрес значения не имеет.

Экран просмотра и изменения сетевого адреса – в соответствии с рисунком 1.9.



Рисунок 1.9

Установить нужный сетевой адрес.

1.5.4.5 Режим просмотра версии ПО на индикаторе блока преобразовательного

Экран, например, в соответствии с рисунком 1.10.

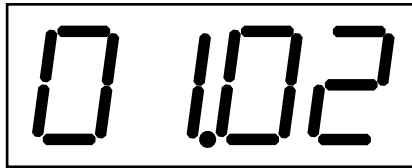


Рисунок 1.10

Версия ПО заносится в память анализатора при прошивке микропроцессора.

1.5.4.6 Режим просмотра и изменения скорости обмена блока преобразовательного с ПК

Экран, например, в соответствии с рисунком 1.11.



Рисунок 1.11

Выбрать нужную скорость обмена из ряда: 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6 бит/с.

1.5.5 Индикация ошибок

Сообщение в соответствии с рисунком 1.12 появляется при отсутствии напряжения питания датчиков при любом выбранном канале индикации КРК. Сопровождается звуковым сигналом.

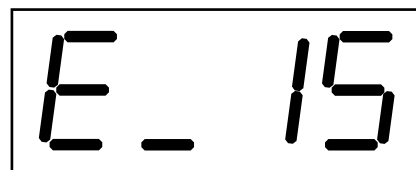


Рисунок 1.12

Сообщение в соответствии с рисунком 1.13 появляется при выбранном типе токового выхода 4-20 мА, если в выбранном канале ток датчика менее 4 мА. Сопровождается звуковым сигналом.

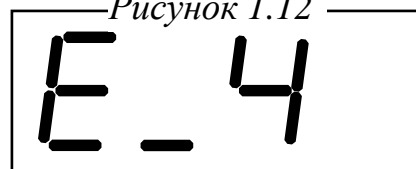


Рисунок 1.13

Если канал не выбран, индикатор включенного канала при токе датчика менее 3,97 мА мигает. Если индикация канала отключена (тип токового выхода не выбран), сигнализации нет.

Сообщение в соответствии с рисунком 1.14 появляется, если в выбранном канале ток датчика более 30 мА. Сопровождается звуковым сигналом.

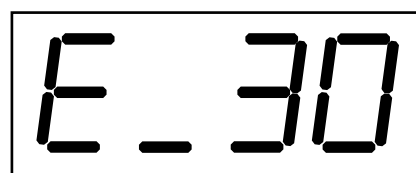


Рисунок 1.14

Если канал не выбран, индикатор включенного канала при токе датчика более 30 мА мигает. Если индикация канала отключена (тип токового выхода не выбран), сигнализации нет.

Сообщение в соответствии с рисунком 1.15 появляется при ошибке записи в память анализатора измененных параметров. Сопровождается звуковым сигналом.

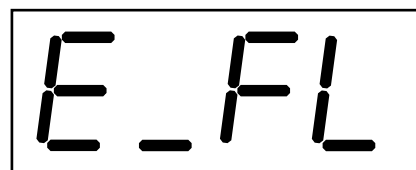


Рисунок 1.15

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Анализатор может использоваться для измерений в различных поверхностных и сточных водах, в том числе мутных и окрашенных, с наличием органических загрязнителей. По некоторым из компонентов, которые могут влиять на результаты измерений, допустимые концентрации приведены в п. 1.2.6.

2.1.2 Блок преобразовательный и модуль токового выхода должны располагаться таким образом, чтобы не было прямого попадания воды.

Модуль токового выхода выполнен в корпусе со степенью защиты IP65 по ГОСТ 14254-2015.

Датчик выполнен в корпусе со степенью защиты IP68 по ГОСТ 14254-2015.

2.1.3 При работе с анализатором оберегать датчик и блок преобразовательный от ударов, так как в их конструкции использовано стекло.

2.2 Указание мер безопасности

2.2.1 К работе с анализатором растворенного кислорода допускается персонал, изучивший настоящее руководство и правила работы с химическими растворами.

2.2.2 Обслуживающий персонал должен быть проинструктирован и иметь допуск к работе с электроустановками до 1000 В в соответствии с действующими правилами техники безопасности.

2.2.3 Блок преобразовательный должен размещаться в месте, не затрудняющем отключение анализатора от сети питания.

2.2.4 Подключение к сети питания должно осуществляться с помощью розетки, имеющей контакт заземления.

2.2.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать крышку подключенного к сети питания блока преобразовательного.

2.2.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать анализатор при открытой крышке блока преобразовательного.

2.3 Подготовка анализатора к работе и проведение измерений

2.3.1 Получение анализатора

При получении анализатора следует вскрыть упаковку, проверить комплектность и убедиться в сохранности упакованных изделий.

После пребывания анализатора на холодном воздухе необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 1 ч, после чего можно приступить к подготовке анализатора к работе.

2.3.2 Подготовка блока преобразовательного

2.3.2.1 Установка блока преобразовательного

Установить блок преобразовательный в помещении в соответствии с требованиями п. 1.2.7 в месте, не затрудняющем отключение анализатора от сети питания.

Разметка для крепления блока преобразовательного – в соответствии с рисунком 2.1.

Подвести сетевое питание ~220 В, 50 Гц.

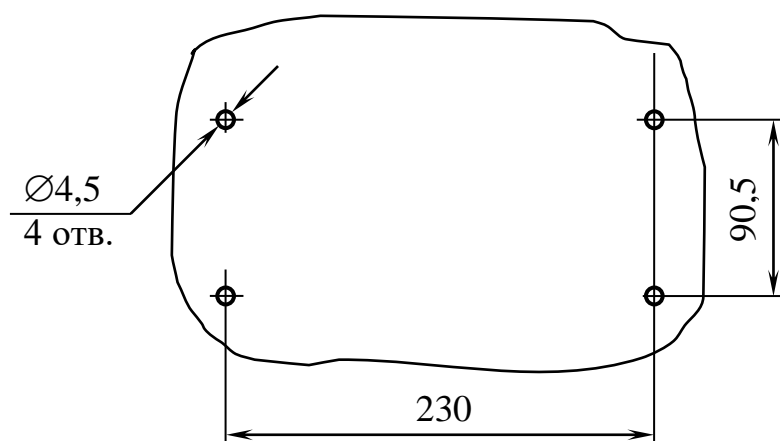


Рисунок 2.1 – Разметка отверстий для крепления блока преобразовательного

2.3.2.2 Подключение внешнего регистрирующего устройства

Схема подсоединения регистрирующего устройства к разъему «**ВЫХОД**» с помощью розетки ВР16.01.400 – в соответствии с таблицей 2.1 и рисунком 2.2.

Таблица 2.1

| № канала | № контакта | Цепь | № канала | № контакта | Цепь |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 | 1 | $I_{вых}$ | 4 | 4 | $I_{вых}$ |
| | 9 | Корпус | | 12 | Корпус |
| 2 | 2 | $I_{вых}$ | 5 | 5 | $I_{вых}$ |
| | 10 | Корпус | | 13 | Корпус |
| 3 | 3 | $I_{вых}$ | 6 | 6 | $I_{вых}$ |
| | 11 | Корпус | | 14 | Корпус |

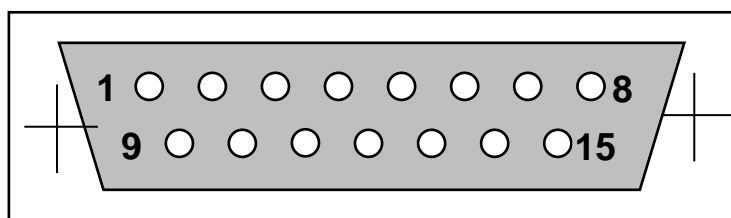


Рисунок 2.2 – Схема расположения контактов розетки ВР16.01.400 (вид со стороны пайки контактов)

Подсоединить внешнее регистрирующее устройство в соответствии с таблицей 2.1, сняв соответствующие переключатели.

Входные каскады регистрирующего устройства должны иметь дифференциальный вход для приема токовых сигналов либо должны быть гальванически развязаны от общей заземляющей шины. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40 МОм.

2.3.2.3 Подключение интерфейса RS-485

Подсоединение порта RS-485 ПК к блоку преобразовательному производится к контактам разъема «**ВЫХОД**» с помощью розетки ВР16.01.400 в соответствии с таблицей 2.2.

Таблица 2.2

| Конт. | Цепь |
|-------|--------------------------|
| 15 | SG (сигнальная земля) |
| 7 | DAT+ (Данные +) |
| 8 | DAT- (Данные -) |

ВНИМАНИЕ: Соединение компьютера с блоком преобразовательным производить при отключенном питании компьютера и блока преобразовательного!

Параметры конфигурации СОМ-порта ПК:

- скорость обмена выбирается при настройке анализатора (п. 1.5.4);
- количество бит данных – 8;
- количество «СТОП-БИТ» – 1;
- контроль паритета – ЧЕТНОСТЬ (EVEN).

2.3.3 Подготовка датчика кислородного

2.3.3.1 Общие сведения

Датчик (в комплекте анализатора) поставляется в сухом виде и при получении его необходимо заполнить электролитом из комплекта поставки в соответствии с п. 2.3.3.2.

Подключить разъем модуля токового выхода с помощью кабельной вставки ВК404.L к одному из каналов блока преобразовательного в соответствии с п. 2.3.3.3.

Включить анализатор.

Установить в соответствии с п. 1.5.4 во всех каналах тип токового выхода, соответствующий типу подключенного датчика:

- для датчиков кислородных ДК-404 – 0-20 мА;
- для датчиков кислородных ДК-404/1 – 4-20 мА.

Отключить индикацию КРК в каналах, где датчики кислородные не установлены, либо установить тип токового выхода 0-20 мА.

Погрузить датчик мембраной вниз на 8 ч в дистиллированную воду.

Провести проверку нижней точки диапазона измерений и градуировку датчика кислородного по атмосферному воздуху в соответствии с пп. 2.3.4 и 2.3.5.

Произвести указанные операции с каждым из датчиков, входящих в комплект анализатора.

2.3.3.2 Заливка электролита ЭК

При выполнении данной операции используются электролит ЭК (далее электролит) и шприц, входящие в комплект инструмента и принадлежностей ВР16.02.600 и поставляемые с анализатором.

1 ВНИМАНИЕ: Электролит ЭК имеет щелочную реакцию! **СОБЛЮДАТЬ** меры предосторожности, приведенные в приложении Г!

2 ВНИМАНИЕ: Заполнение электролитом ЭК датчика и его сборку проводить в перчатках над поддоном из химически стойкого материала!

Состав электролита ЭК: КСl, хч – 14 г; КОН, хч – 0,2 г; трилон Б – 0,15 г; вода дистиллированная до 0,1 дм³. Раствор профильтровать.

Для заполнения датчика электролитом в соответствии с рисунком 2.3 следует:

- расположить датчик вертикально, мембранным узлом вниз;
- отвернуть от внутреннего корпуса мембранный узел;
- залить с помощью шприца электролит в мембранный узел на 2/3 от объема;
- навернуть мембранный узел на внутренний корпус;
- ополоснуть датчик проточной водой.

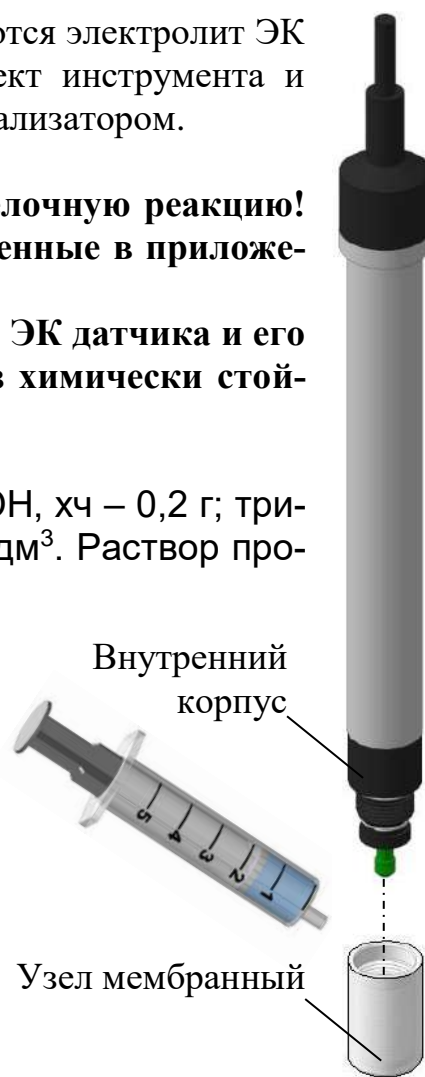


Рисунок 2.3

2.3.3.3 Подключение датчиков кислородных к блоку преобразовательному

ВНИМАНИЕ: Блок преобразовательный должен быть отключен от сети питания!

Подключение датчиков кислородных к блоку преобразовательному производится с помощью вставок кабельных ВК404.L (в дальнейшем вставка кабельная), рисунок 2.4.

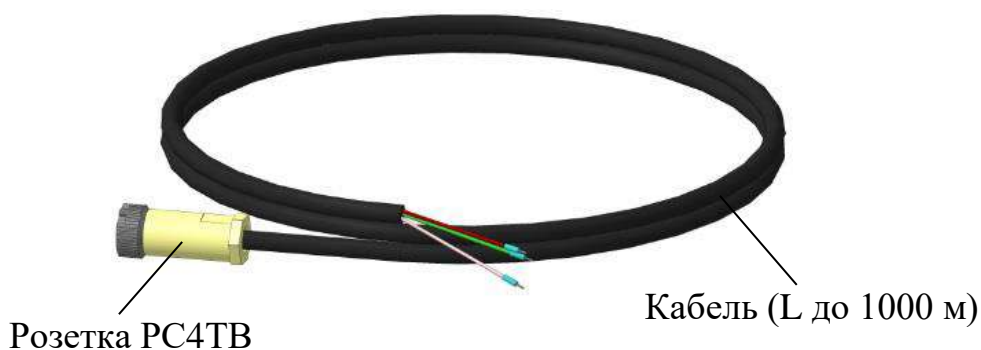


Рисунок 2.4 – Вставка кабельная ВК404.L

Отвернуть четыре винта крепления откидывающейся крышки блока преобразовательного и открыть доступ к клеммнику DG142V-03P, расположенным на плате в соответствии с рисунком 2.5.

Один конец вставки кабельной пропустить через герметичный кабельный ввод на нижней поверхности блока преобразовательного, предварительно удалив заглушку из герметичного кабельного ввода, и подключить жилы кабельной вставки к клеммнику DG142V-03P в соответствии с таблицей 2.3.

Таблица 2.3

| Маркировка жил кабельной вставки | № контакта | | Цепь |
|----------------------------------|----------------------|---------------|----------|
| | клеммника DG142V-03P | розетки РС4ТВ | |
| 2 | 2 | 2 | I_{ex} |
| 3 | 1 | 3 | +15 В |
| 4 | 3 | 4 | GND |

При работе анализатора неиспользуемые герметичные кабельные вводы должны быть закрыты заглушками.

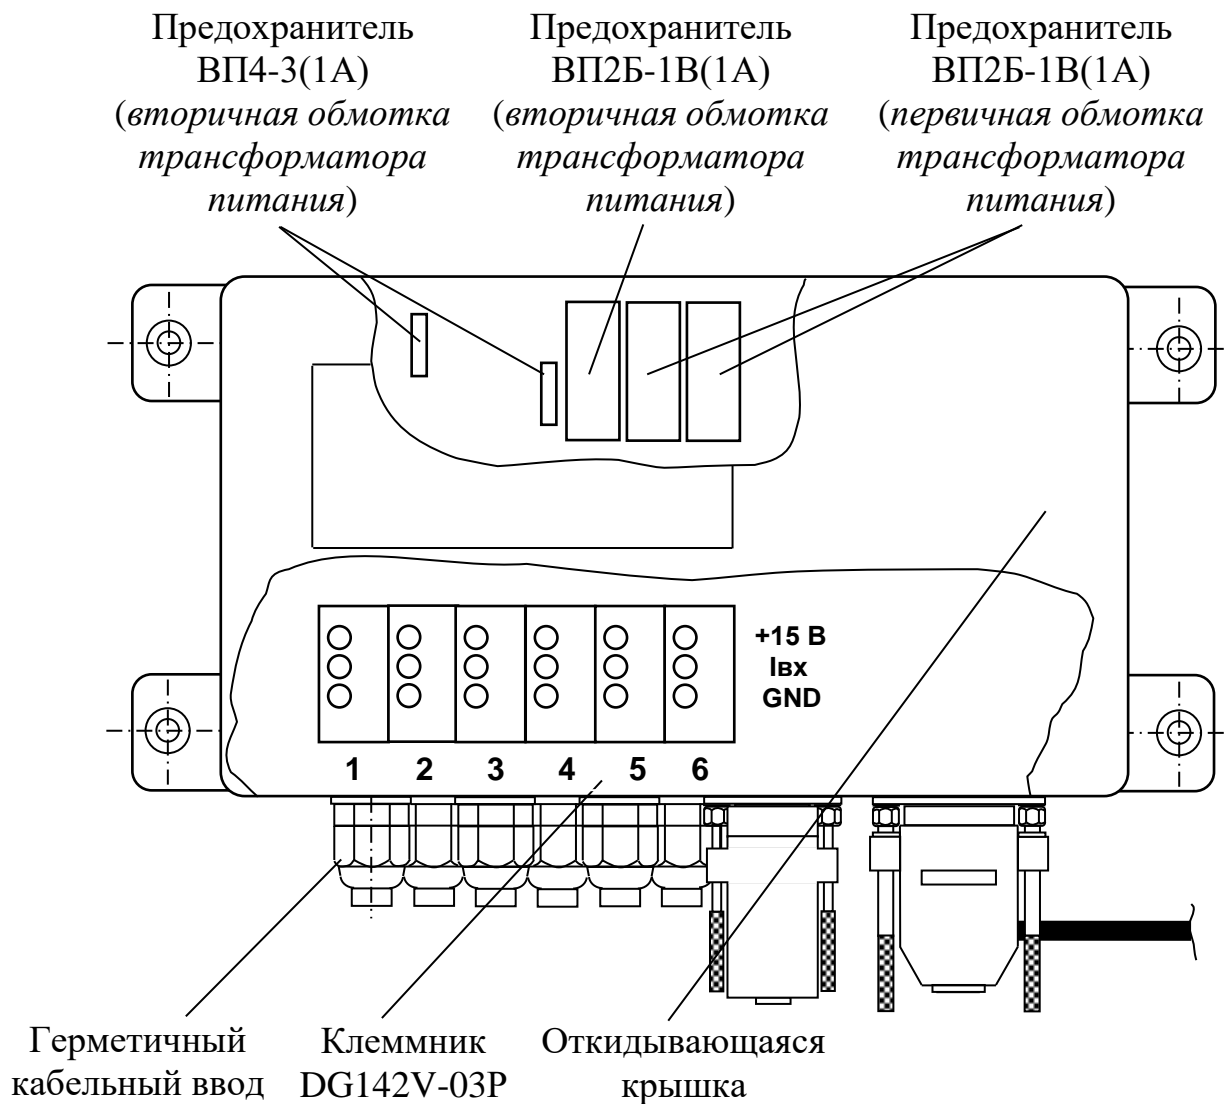


Рисунок 2.5 – Схема расположения клеммников DG142V-03P и предохранителей под откидывающейся крышкой блока преобразовательного

Второй конец кабельной вставки подключить к модулю токового выхода розеткой РС4ТВ, установленной на кабельной вставке в соответствии с рисунком 2.6 и таблицей 2.3.




Рисунок 2.6 – Схема расположения контактов розетки РС4ТВ (вид со стороны пайки контактов)

Погрузить датчик мембраной вниз на 8 ч в дистиллированную воду.

2.3.4 Проверка нижней точки диапазона измерения

Приготовить бескислородный («нулевой») раствор. Для этого следует:

- залить в сосуд 100 см³ дистиллированной воды, комнатной температуры;
- добавить 1 г натрия сернистоокислого и перемешать;
- добавить 2 см³ раствора кобальта хлористого б-водного массовой концентрацией 2 г/дм³;
- перемешать стеклянной палочкой.

Срок хранения готового раствора в плотно закрытой посуде 1 месяц с момента изготовления.

Примечание – Комплект химических реактивов для приготовления «нулевого» раствора ВР20.20.000 поставляется по отдельной заявке.

Подключить разъем модуля токового выхода кабелем градуировки К404.1, входящим в комплект анализатора, к разъему канала «ГРАДУИР» либо к любому свободному каналу и включить кнопками « \leftarrow » или « \rightarrow », расположенными на передней панели анализатора, индикацию этого канала.

Погрузить датчик кислородный в приготовленный раствор в соответствии с рисунком 2.7. Встряхнуть его в растворе, чтобы исключить скапливание пузырьков воздуха на мембране.

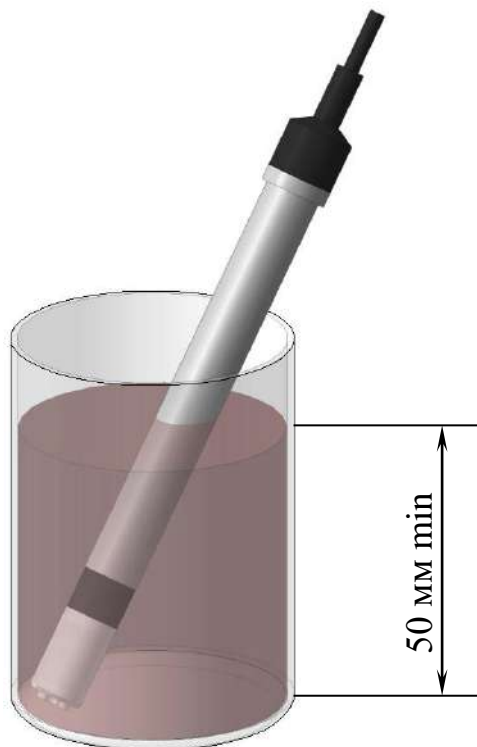


Рисунок 2.7 – Положение датчика при проверке нижней точки диапазона измерения

Через 10 мин снять показания анализатора. Они должны находиться в пределах от минус 0,050 до плюс 0,050 мг/дм³.

Если показания не опускаются до указанного значения, сделать несколько энергичных встряхиваний датчика, не вынимая его из раствора, чтобы удалить пузырьки воздуха с мембраны.

Если в результате вышеуказанных действий не удастся получить требуемые показания, то это может свидетельствовать либо о плохом качестве «нулевого» раствора (плохих реактивах), либо о неисправности анализатора (раздел 2.5 «Возможные неисправности и методы их устранения»).

Произвести указанные операции с каждым из датчиков кислородных, входящих в комплект анализатора.

Проверку нижней точки диапазона измерения *рекомендуется* производить при появлении сомнений в исправности анализатора.

2.3.5 Градуировка датчика кислородного

Градуировку датчика кислородного по атмосферному воздуху следует проводить:

- при вводе в эксплуатацию после получения либо после длительного хранения;
- один раз в неделю;
- при проведении поверки;
- после замены электролита или узла мембранного.

Данную операцию можно проводить:

- в помещении при комнатной температуре от плюс 5 до плюс 35 °С;
- в водоеме при температуре, равной температуре анализируемой воды.

В этом случае погрешность измерения уменьшится, так как исключается дополнительная погрешность, обусловленная изменением температуры анализируемой воды. Градуировка датчика кислородного в водоеме проводится при температуре анализируемой воды от плюс 5 до плюс 35 °С с помощью устройства для градуировки К-404, поставляемого по отдельной заявке.

2.3.5.1 Градуировка датчика кислородного по атмосферному воздуху в помещении

Градуировка датчика кислородного производится в атмосферном воздухе при относительной влажности 100 % и комнатной температуре от плюс 15 до плюс 35 °С.

Блок преобразовательный и модуль токового выхода до градуировки должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 1 ч.

Модуль токового выхода датчика кислородного подключить кабелем градуировки К-404.1 к каналу «ГРАДУИР». Выбрать индикацию КРК канала «ГРАДУИР».

Для выполнения градуировки произвести следующие операции:

а) полностью погрузить датчик в дистиллированную воду комнатной температуры на время не менее 20 мин;

б) стряхнуть капли воды с мембраны датчика и протереть весь датчик сухой тканью. Поместить датчик в коническую колбу КН-100-19/26 или аналогичную, на дно которой налита вода в количестве 20-30 см³ в соответствии с рисунком 2.8. Колбу расположить наклонно под углом 15-45° к горизонтали.

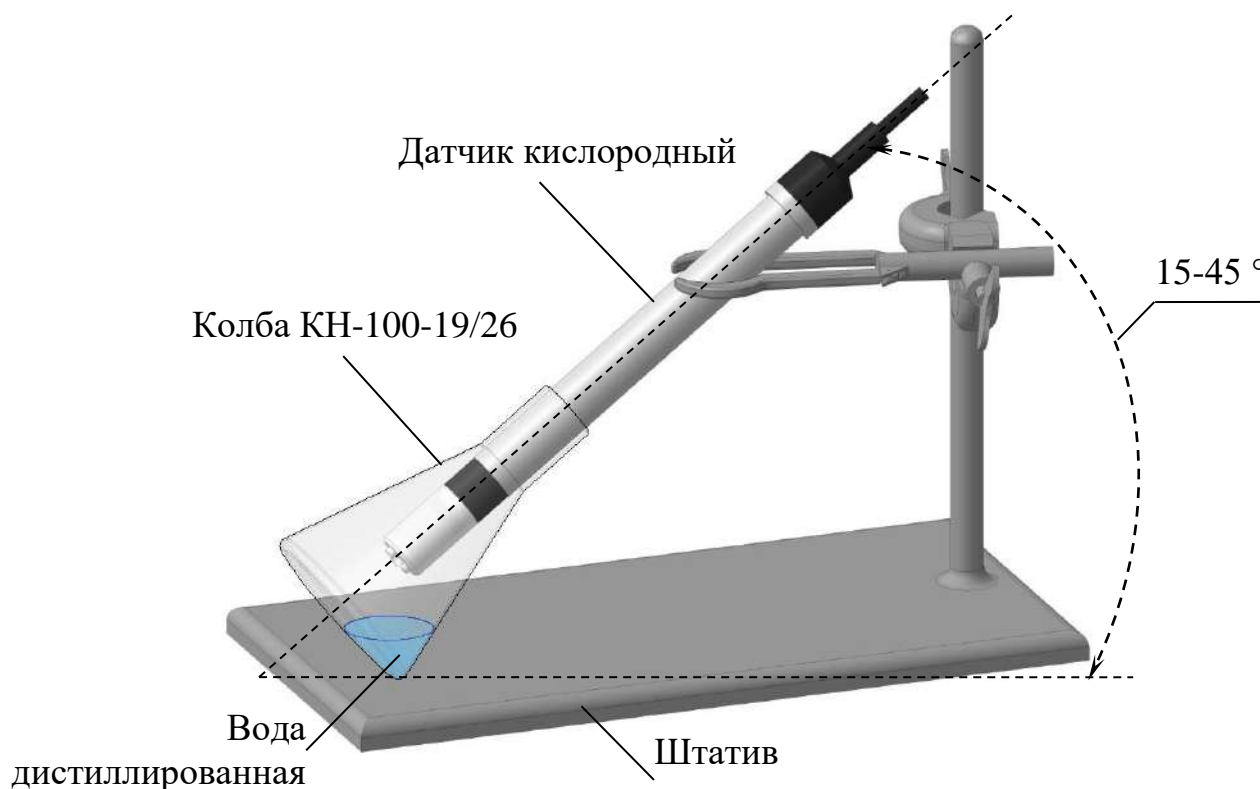


Рисунок 2.8 – Положение датчика в колбе при градуировке по атмосферному воздуху

Примечание – Допускается проводить градуировку по атмосферному воздуху без конической колбы. Датчик ополоснуть дистиллированной водой комнатной температуры, стряхнуть капли воды с мембраны и разместить под углом 15-30° к горизонтали.

в) через 10 мин измерить и зафиксировать по барометру атмосферное давление $P_{атм}$, кПа. Измерить температуру окружающего воздуха термометром с погрешностью $\pm 0,2$ °С;

г) вращая шлиц градуировки, расположенный на торцевой поверхности модуля токового выхода, установить с точностью $\pm 0,5\%$ показания $C_{град}$, мг/дм³, контролируя их по индикатору блока преобразовательного, равными

$$C_{град} = Co_2(t) \cdot \frac{P_{атм}}{101,325},$$

где $Co_2(t)$ – значение КРК для измеренной температуры воздуха, взятое из таблицы Б.1, мг/дм³;

$P_{атм}$ – атмосферное давление на момент градуировки, кПа.

Если соответствующее значение выставить, не удастся, следует обратиться к разделу 2.5 «Возможные неисправности и методы их устранения».

После градуировки каждого из датчиков кислородных, входящих в комплект анализатора, анализатор готов к работе.

2.3.5.2 Градуировка датчика кислородного по атмосферному воздуху в водоеме с использованием устройства для градуировки К-404 – в соответствии с п. 2.4 руководства по эксплуатации ВР16.04.000РЭ.

2.3.6 Подготовка к проведению измерений

При подготовке используется комплект монтажных частей ВР16.02.400, состоящий из держателя датчика ВР16.02.410, пенала модуля токового выхода ВР16.02.420 и отвода (водоотвод 1/2 дюйма), и входящий в комплект поставки.

Условная схема размещения составных частей анализатора приведена на рисунке 2.9.

При выборе места расположения датчиков следует учесть, что для правильного измерения КРК необходимо движение воды относительно датчика со скоростью не менее 5 см/с.

Установить и закрепить модуль токового выхода датчика кислородного в условиях, соответствующих п. 1.2.7, используя пенал модуля токового выхода (в дальнейшем пенал). Габаритные и присоединительные размеры пенала – в соответствии с рисунком 2.10.

Для крепления пенала необходимо снять с трубы стойки с защелкой, закрепить их снизу под навесом либо на вертикальной или горизонтальной поверхности и установить трубу на стойки с защелкой.

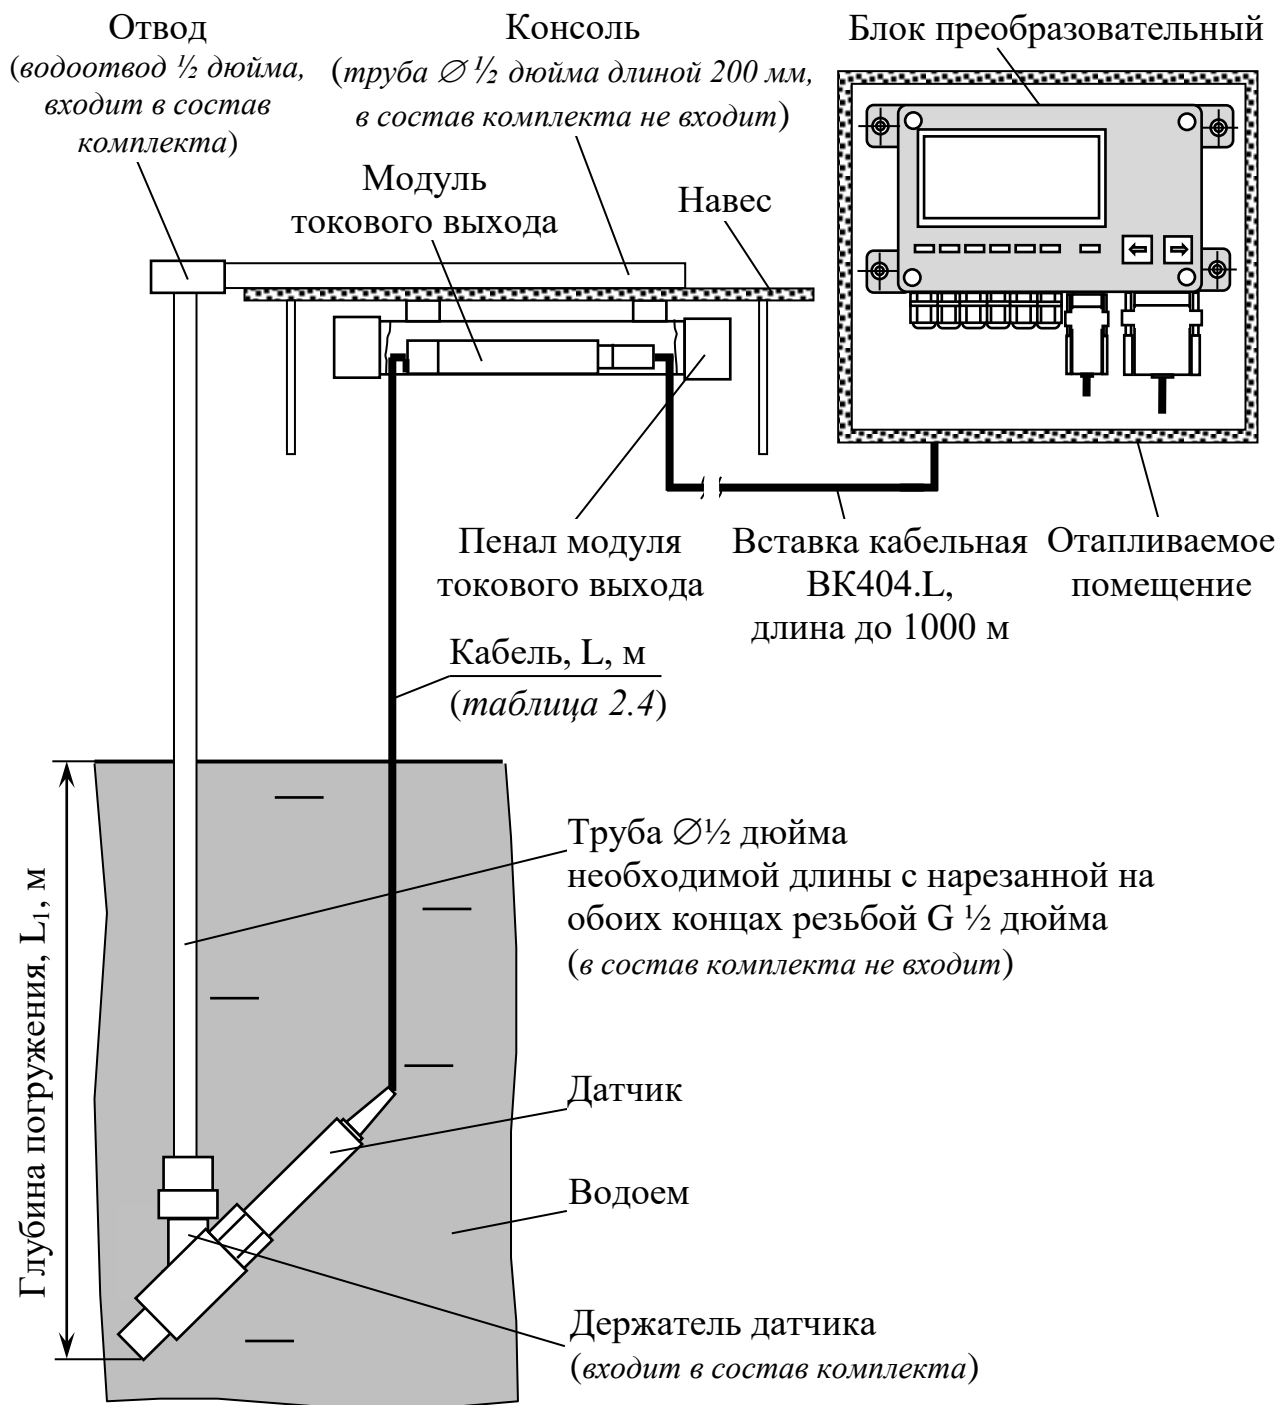


Рисунок 2.9 – Условная схема размещения составных частей анализатора

Таблица 2.4

| Тип кабеля, установленного на датчик | Глубина погружения L_1 , м, не более |
|--|--|
| Кабель, $L = 5$ м | 5 |
| Кабель удлиненный, L до 20 м (устанавливается на датчик по специальному заказу) | 20 |

ВНИМАНИЕ: Прорези для кабеля ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ СНИЗУ трубы во избежание попадания капель воды!

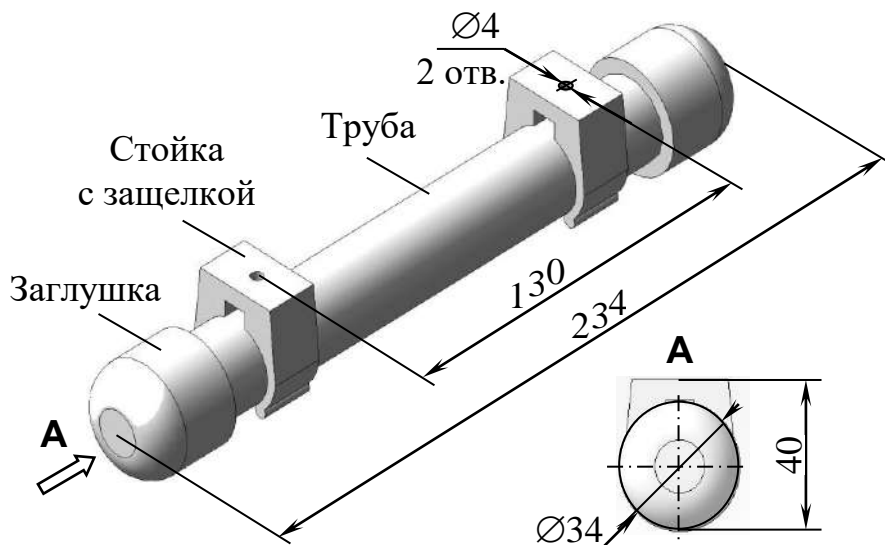


Рисунок 2.10 – Габаритные и присоединительные размеры пенала модуля токового выхода

Соединить с помощью кабельных вставок необходимой длины модуль токового выхода каждого датчика кислородного и соответствующий канал измерения блока преобразовательного.

Установить датчик в держатель датчика, в соответствии с рисунком 2.11, для этого следует ослабить гайку уплотнения, установить датчик и завернуть гайку. Развернуть тройник держателя датчика, чтобы при установке в точке измерения он находился под углом 45° к вертикали.

Установить и закрепить датчики в местах, где требуется контроль КРК. Датчики должны быть погружены в воду полностью.



Рисунок 2.11 – Держатель датчика с установленным датчиком кислородным

2.3.7 Проведение измерений

После установки датчиков кислородных в местах контроля КРК и проведения градуировки по атмосферному воздуху можно снять установившиеся показания анализатора.

Датчик кислородный позволяет осуществлять измерение КРК на глубинах до 20 м при поставке по специальному заказу с удлиненным кабелем (таблица 2.4).

ВНИМАНИЕ! При работе с анализатором:

- транспортировать датчик кислородный, заполненный электролитом, необходимо при температуре окружающего воздуха выше нуля во избежание замерзания электролита;
- при переносе блока преобразовательного с холодного воздуха в теплое помещение необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре не менее 1 ч для испарения сконденсированной на поверхности разъемов влаги.

2.3.8 Расчет абсолютного значения КРК при измерениях в соленой воде

Расчет производится по формуле

$$C = \alpha \cdot C_{изм},$$

где α – поправочный коэффициент;

$C_{изм}$ – измеренное значение КРК, мг/дм³.

Значение α определяется формулой

$$\alpha = 1 - A \cdot \varepsilon,$$

где A – содержание солей, г/дм³;

ε – коэффициент, приведенный в таблице 2.5.

Пример расчета КРК с учетом поправочного коэффициента α :

Пусть измеренное значение КРК 5,6 мг/дм³, $A=10$ г/дм³.

$t=20$ °С, следовательно $\varepsilon=0,0053$; тогда

$$\alpha = 1 - 10 \cdot 0,0053 = 0,947;$$

$$C = 0,947 \cdot 5,6 = 5,30.$$

Таблица 2.5 – Поправочные коэффициенты

| $t, ^\circ\text{C}$ | ε | $t, ^\circ\text{C}$ | ε | $t, ^\circ\text{C}$ | ε | $t, ^\circ\text{C}$ | ε | $t, ^\circ\text{C}$ | ε |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 0,0 | 0,0063 | 11,0 | 0,0057 | 21,0 | 0,0052 | 31,0 | 0,0048 | 41,0 | 0,0043 |
| 1,0 | 0,0063 | 12,0 | 0,0057 | 22,0 | 0,0052 | 32,0 | 0,0047 | 42,0 | 0,0042 |
| 2,0 | 0,0062 | 13,0 | 0,0057 | 23,0 | 0,0051 | 33,0 | 0,0047 | 43,0 | 0,0042 |
| 3,0 | 0,0062 | 14,0 | 0,0055 | 24,0 | 0,0050 | 34,0 | 0,0046 | 44,0 | 0,0041 |
| 4,0 | 0,0060 | 15,0 | 0,0055 | 25,0 | 0,0050 | 35,0 | 0,0046 | 45,0 | 0,0045 |
| 5,0 | 0,0060 | 16,0 | 0,0055 | 26,0 | 0,0049 | 36,0 | 0,0045 | 46,0 | 0,0040 |
| 6,0 | 0,0060 | 17,0 | 0,0054 | 27,0 | 0,0049 | 37,0 | 0,0045 | 47,0 | 0,0040 |
| 7,0 | 0,0060 | 18,0 | 0,0054 | 28,0 | 0,0049 | 38,0 | 0,0044 | 48,0 | 0,0039 |
| 8,0 | 0,0058 | 19,0 | 0,0053 | 29,0 | 0,0048 | 39,0 | 0,0044 | 49,0 | 0,0039 |
| 9,0 | 0,0058 | 20,0 | 0,0053 | 30,0 | 0,0048 | 40,0 | 0,0043 | 50,0 | 0,0038 |
| 10,0 | 0,0058 | | | | | | | | |

Примечание – Данная методика поправки на солесодержание разработана на основе данных, приведенных в Международном стандарте ISO 5814 Качество воды. Определение растворенного кислорода методом электрохимического датчика.

2.3.9 Пересчет показаний C , мг/дм³, в показания Z , % O₂

Пересчет производится по формуле

$$Z = \frac{C}{C_{O_2}} \cdot 100\%,$$

где C – показания анализатора, мг/дм³;

C_{O_2} – найденное по таблице Б.1 значение растворимости кислорода воздуха в дистиллированной воде для определенной заранее температуры анализируемой среды, мг/дм³.

2.4 Проверка технического состояния

Показателем нормального технического состояния анализатора является выполнение следующих условий:

1) при проверке нижней точки диапазона измерения для каждого из датчиков кислородных, входящих в комплект анализатора, показания блока преобразовательного опускаются до значений в пределах от минус 0,050 до плюс 0,050 мг/дм³ (п. 2.3.4);

2) при градуировке по атмосферному воздуху с помощью шлицов градуировки устанавливаются необходимые показания блока преобразовательного для каждого из датчиков кислородных, входящих в комплект анализатора (п. 2.3.5).

2.5 Возможные неисправности и методы их устранения

2.5.1 Характерные неисправности анализатора и методы их устранения приведены в таблице 2.6.

При возникновении неисправностей, указанных в таблице 2.6, следует выполнить действия, рекомендуемые в графе «методы устранения» (смотри нижеследующие пункты и рисунки 1.1, 2.11).

Таблица 2.6

| Неисправность | Вероятная причина | Методы устранения |
|--|--------------------------------|--|
| Анализатор не включается | Неисправен сетевой кабель. | Проверить сетевой кабель |
| | Вышли из строя предохранители. | п. 3.3.6 Замена сетевых предохранителей. |
| При градуировке не удается выставить необходимые показания индикатора. | Вытек электролит | п. 2.3.3.2. Залить электролит |
| | Загрязнена мембрана | п. 3.3.3. Очистить мембрану |

Продолжение таблицы 2.6

| Неисправность | Вероятная причина | Методы устранения |
|---|--|---|
| <p>При градуировке не удастся выставить необходимые показания индикатора.</p> <p>При градуировке либо при измерениях на индикаторе появилось сообщение E_30.</p> | Дефекты мембраны | п. 3.3.4. Заменить мембранный узел |
| <p>На индикаторе появилось сообщение E_4 (при типе токового выхода 4-20 мА ток датчика менее 3,97 мА)</p> | Неправильно установлен тип токового выхода (установлен 4-20 мА для датчика ДК-404). | Установить тип токового выхода 0-20 мА |
| | Отсутствует розетка ВР16.01.400 либо отсутствует контакт розетки ВР16.01.400 с блоком преобразовательным | Установить розетку ВР16.01.400. Проверить и обеспечить надежное соединение розетки ВР16.01.400 с блоком преобразовательным |
| | Неправильное подключение внешнего регистрирующего устройства | пп. 2.3.2.3, 2.3.3.3. Проверить правильность соединения |
| | Неисправна розетка ВР16.01.400 | Ремонт в заводских условиях |
| <p>На индикаторе появилось сообщение E_FL</p> | Ошибка записи в память анализатора измененных параметров. | При часто появляющемся сообщении – ремонт в заводских условиях |
| <p>На индикаторе появилось сообщение E_15 (отсутствие напряжения питания датчиков)</p> | Неисправность одного из датчиков либо блока преобразовательного | Отключить поочередно все датчики. Ремонт неисправного датчика в заводских условиях. Если после отключения всех датчиков, проверки и замены сетевых предохранителей (ВП2Б-1В(1А)) ошибка сохранилась, то ремонт блока преобразовательного в заводских условиях. |

Продолжение таблицы 2.6

| Неисправность | Вероятная причина | Методы устранения |
|---|--|------------------------------------|
| Длительное время реагирования на изменение концентрации кислорода при установленном времени усреднения показаний, равном нулю | Загрязнена мембрана | п. 3.3.3. Очистить мембрану |
| Вытекает электролит | Разрыв мембраны | п. 3.3.4. Заменить мембранный узел |
| Велики показания в нулевом растворе | Разрыв мембраны | п. 3.3.4. Заменить мембранный узел |
| | Загрязнение электролита | п. 3.3.4. Заменить электролит |
| | Попала влага внутрь блока преобразовательного | Ремонт в заводских условиях |
| | Попала влага на платы модуля токового выхода либо на плату датчика кислорода | |

При выявлении неуказанных неисправностей или невозможности устранения неисправности своими силами следует обратиться в ООО «ВЗОР».

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Меры безопасности

Все виды технического обслуживания (далее – ТО) выполняются квалифицированным оперативным персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации и меры безопасности при работе с химическими реактивами.

3.2 Общие указания

Техническое обслуживание для анализатора, находящегося в эксплуатации, включает в себя операции нерегламентированного и регламентированного обслуживания.

В состав нерегламентированного ТО входят:

- эксплуатационный уход;
- содержание анализатора в исправном состоянии, включая устранение неисправностей;
- своевременная замена изношенных узлов и деталей.

Все обнаруженные при нерегламентированном ТО неисправности в работе анализатора должны быть устранены силами оперативного персонала.

Регламентированное ТО реализуется в форме плановых ТО, объем и периодичность которых приведены в таблице 3.1.

Обнаруженные при ТО дефекты узлов и деталей, которые при дальнейшей эксплуатации оборудования могут нарушить его работоспособность или безопасность условий труда, должны немедленно устраняться. При невозможности устранения дефектов своими силами следует подготовить анализатор, упаковать и отправить его предприятию-изготовителю для осуществления ремонта.

Таблица 3.1

| № пп. РЭ | Наименование работы | Периодичность ТО | |
|--|--|----------------------|----------|
| | | один раз в неделю | ежегодно |
| 3.3.1 | Внешний осмотр | * | + |
| 3.3.2 | Проверка функционирования анализатора | * | + |
| 3.3.3 | Чистка составных частей анализатора | * | + |
| 3.3.4 | Замена: – электролита ЭЖ; – узла мембранного. | * * | + * |
| 3.3.5 | Замена кольца уплотнительного | * | * |
| 3.3.6 | Замена сетевых предохранителей | * | * |
| 2.3.4 | Проверка нижней точки диапазона измерений | * | + |
| 2.3.5 | Градуировка датчика кислородного по атмосферному воздуху | + | + |
| Условные обозначения: «+» – ТО проводят; «*» – ТО проводят при необходимости. | | | |

3.3 Техническое обслуживание составных частей

3.3.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра анализатора проверяют:

- отсутствие механических повреждений датчика кислородного и блока преобразовательного;
- целостность разъемов, кнопок, соединительных кабелей;
- правильность и четкость маркировки.

3.3.2 Чистка составных частей анализатора

3.3.2.1 Чистку наружной поверхности блока преобразовательного, в случае загрязнения, производить с использованием мягких моющих средств с последующим очищением мягкой тканью, смоченной в дистиллированной воде.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАТЬ попадания влаги внутрь блока преобразовательного!

Примечание – В качестве мягкого моющего средства можно использовать мыльный раствор: 40-50 г стружки мыла по ГОСТ 28546-2002 растворить в 300-400 см³ горячей воды.

3.3.2.2 Для очистки мембраны датчика ее можно протереть ваткой, смоченной в спирте. Можно также погрузить датчик мембраной в слабый раствор (2 %) серной кислоты на время около 1 ч, после чего промыть его в проточной воде.

3.3.2.3 Очистка платинового электрода, в случае необходимости, осуществляется сначала мягкой тканью, смоченной спиртом, затем – сухой тканью.

ВНИМАНИЕ: НЕ ЧИСТИТЬ ЭЛЕКТРОДЫ АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ!

После очистки электродов промыть датчик в дистиллированной воде.

3.3.3 Проверка функционирования анализатора

Для проведения проверки функционирования анализатора в различных режимах работы включают анализатор и проверяют работоспособность кнопок « \Leftrightarrow », « \Rightarrow ».

Результат проверки считают удовлетворительным, если при нажатии кнопки « \Leftrightarrow » или « \Rightarrow » переключается канал индикации.

3.3.4 Замена узла мембранного и электролита ЭК

ВНИМАНИЕ: При сборке или разборке датчика проверить состояние кольца уплотнительного 011-014-19 и ЗАМЕНИТЬ его при необходимости в соответствии с п. 3.3.5!

В процессе эксплуатации количество электролита в датчике может уменьшаться из-за вытекания через микроотверстия в мембране либо при

нарушении герметичности датчика, а именно при механическом повреждении (трещинах, проколах, вытягивании) мембранного узла.

Признаки повреждений мембраны:

- вытекание электролита;
- нестабильность показаний анализатора;
- большие показания в нулевом растворе;
- большое время реагирования при измерении КРК.

Узел мембранный входит в комплект запасных частей ВР16.12.500.

Электролит ЭК входит в комплект инструмента и принадлежностей ВР16.02.600.

Узел мембранный изображен на рисунке 3.1.

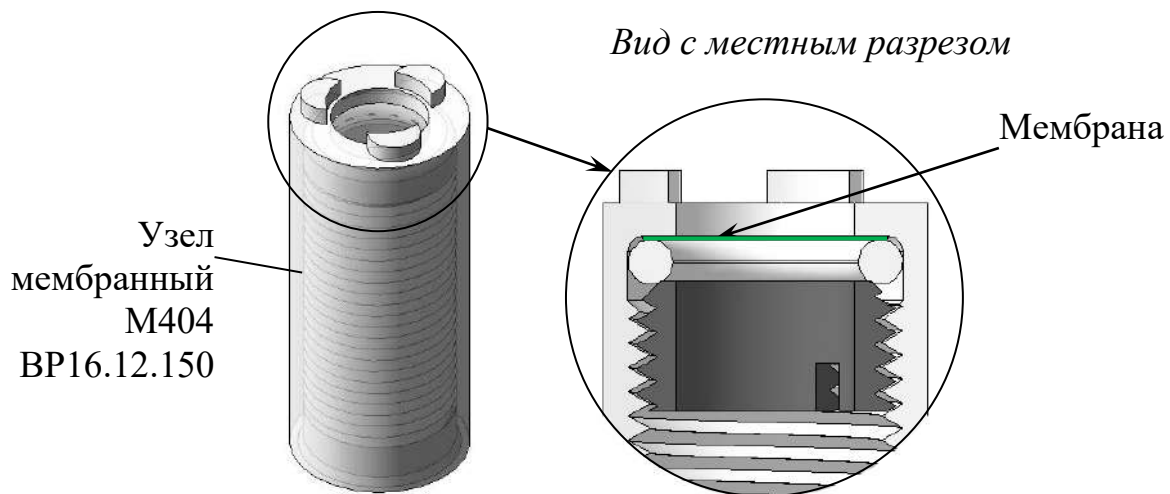


Рисунок 3.1 – Узел мембранный М404

Для замены электролита и узла мембранного следует:

- расположить датчик вертикально мембраной вниз;
- отвернуть от внутреннего корпуса мембранный узел;
- ополоснуть датчик дистиллированной водой;
- заполнить датчик электролитом в соответствии с п. 2.3.3.2 и установить при необходимости новый мембранный узел;
- выдержать датчик на воздухе в течение не менее 1 ч;
- провести проверку нижней точки диапазона измерения (п. 2.3.4);
- провести градуировку датчика кислородного по атмосферному воздуху (п. 2.3.5).

3.3.5 Замена кольца уплотнительного

В конструкции датчика используется кольцо 011-014-19-2-7 ГОСТ 18829-2017 (рисунок 1.2), которое имеет ограниченный ресурс.

Замену кольца 011-014-19-2-7 производить в случае его повреждения.

Кольцо 011-014-19-2-7 входит в комплект запасных частей ВР16.12.500.

3.3.6 Замена сетевых предохранителей

В первичной обмотке трансформатора питания установлены два предохранителя плавких ВП2Б-1В(1А) с номинальным током срабатывания 1 А.

Замена предохранителей ВП2Б-1В(1А) производится после устранения неисправностей, вызвавших разрушение предохранителей.

ВНИМАНИЕ: БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ!

Расположение предохранителей под откидывающейся крышкой блока преобразовательного – в соответствии с рисунком 2.5.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Комплект поставки анализатора соответствует таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование | Обозначение | Количество |
|---|-------------------------------|------------|
| 1 Блок преобразовательный (с розеткой ВР16.01.400) | ВР16.01.000 | 1 |
| 2 Датчик кислородный: – ДК-404; – ДК-404/1. | ВР16.02.000 ВР16.02.000-01 | 6* |
| 3 Устройство для градуировки К-404 | ВР16.04.000 | 1** |
| 4 Кабель градуировки К404.1 | ВР16.01.910 | 1 |
| 5 Кабель поверочный К404.0,5 | ВР16.01.920 | 1 |
| 6 Руководство по эксплуатации | ВР16.00.000РЭ | 1 |
| * Тип датчиков и количество по согласованию с заказчиком. | | |
| ** По согласованию с заказчиком. | | |

4.2 Комплект поставки каждого датчика кислородного соответствует таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Наименование | Обозначение | Количество |
|--|--|------------|
| 1 Датчик кислородный: – ДК-404; – ДК-404/1. | ВР16.02.000 ВР16.02.000-01 | 1 |
| 2 Вставка кабельная ВК404.L** | ВР16.02.300 | 1* |
| 3 Комплект монтажных частей: – держатель датчика – 1 шт.; – пенал модуля токового выхода – 1 шт.; – отвод (водоотвод 1/2 дюйма) – 1 шт. | ВР16.02.400 ВР16.02.410 ВР16.02.420 – | 1 |
| 4 Комплект запасных частей: – узел мембранный М404 – 2 шт.; – кольцо 011-014-19-2-7 ГОСТ 18829-2017 – 1 шт. | ВР16.12.500 ВР16.12.150 – | 1 |
| 5 Комплект инструмента и принадлежностей: – электролит ЭК (емкость 50 см ³) – 1 шт.; – отвертка 4 мм – 1 шт.; – шприц 5 см ³ – 1 шт. | ВР16.02.600 ВР47.05.100 – – | 1 |
| 6 Розетка РС4ТВ с кожухом | – | 1*** |
| * По согласованию с заказчиком. | | |
| ** Длина L по согласованию с заказчиком. | | |
| *** Поставляется при отсутствии в комплекте поставки анализатора вставки кабельной ВК404.L. | | |

4.3 Перечень изделий, применяемых с анализатором и поставляемых по отдельной заявке, приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Наименование | Обозначение |
|--|-------------|
| Комплект химических реактивов для приготовления «нулевого» раствора: | ВР20.20.000 |
| – флакон с натрием сернистоокислым (масса нетто 12,5 г) – 1 шт.; | – |
| – флакон с кобальтом хлористым б-водным (масса нетто 1 г) – 1 шт. | – |

5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для проведения работ по контролю и текущему обслуживанию анализатора требуются следующие инструменты и принадлежности, не входящие в комплект поставки анализатора:

- термометр с ценой деления не более 0,2 °С;
- барометр-анероид БАММ-1;
- натрий сернистоокислый ГОСТ 195-77, ч.д.а.;
- кобальт хлористый б-водный ГОСТ 4525-77, ч.д.а.;
- колба КН-100-19/26.

6 МАРКИРОВКА

На передней панели анализатора нанесено наименование прибора и товарный знак.

На боковой поверхности анализатора укреплена табличка, на которой нанесены:

- наименование, тип, модель, модификация изделия;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- знак об утверждении типа;
- порядковый номер анализатора;
- год выпуска.

На нижней поверхности анализатора вблизи ввода сетевого кабеля укреплена табличка, на которой нанесены род тока, напряжение и потребляемая мощность анализатора.

На упаковочной коробке нанесены манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги» и «Верх». На упаковочной коробке наклеена этикетка, содержащая наименование и условное обозначение анализатора, дату упаковки, товарный знак, телефоны, адрес и наименование предприятия-изготовителя.

7 УПАКОВКА

Составные части анализатора укладываются в картонную коробку в полиэтиленовых пакетах.

В отдельные пакеты укладываются:

- блок преобразовательный;
- каждый датчик кислородный ДК-404 (ДК-404/1), входящий в комплект поставки;
- комплект инструмента и принадлежностей;
- комплекты запасных частей к датчикам;
- комплекты монтажных частей;
- руководство по эксплуатации и упаковочная ведомость.

Пространство между пакетами и стенками коробки заполняется амортизационным материалом.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Анализатор растворенного кислорода МАРК-404 ТУ 26.51.53-009-39232169-2018

№ _____

датчики кислородные

ДК-404 № _____

ДК-404/1 № _____

упакован ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

« ____ » _____ 20__ г.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Анализатор растворенного кислорода МАРК-404 ТУ 26.51.53-009-39232169-2018

№ _____

датчики кислородные

ДК-404 № _____

ДК-404/1 № _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

« ____ » _____ 20__ г.

10 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ (КАЛИБРОВКЕ)

Для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений анализаторы при выпуске из производства, после ремонта и при эксплуатации должны подвергаться поверке. Поверку анализаторов осуществляют органы Государственной метрологической службы или аккредитованные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Поверка производится в соответствии с документом «Анализатор растворенного кислорода МАРК-404. Методика поверки», приложение А.

Межповерочный интервал 1 год.

ВНИМАНИЕ: Датчики кислородные ДК-404 и ДК-404/1 принимаются от пользователей для проведения поверки анализаторов (в том числе для ремонта) только в очищенном от грязи виде!

Таблица 10.1

| Поверка (калибровка) | Дата проведения | Должность, ФИО | Подпись, печать | Срок очередной поверки (калибровки) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| Поверка | ___/___/___ | | | ___/_____ |

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие анализатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации анализатора, поставляемого по территории Российской Федерации, – 48 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом и расходных материалов).

11.3 Гарантийный срок эксплуатации анализатора, поставляемого на экспорт, – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом и расходных материалов).

11.4 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать анализатор при выходе его из строя, либо при ухудшении технических характеристик не по вине потребителя.

11.5 Гарантийные обязательства прекращаются при:

- нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации анализатора, установленных в руководстве по эксплуатации;
- нарушении предусмотренных гарантийных пломб;
- наличии признаков несанкционированного ремонта;
- механических повреждениях.

11.6 В гарантийный ремонт принимается анализатор в упаковке, обеспечивающей сохраняемость анализатора при его транспортировании и хранении, в комплекте с руководством по эксплуатации на анализатор и оригиналом рекламации.

11.7 Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и детали с ограниченным ресурсом, подверженные износу при нормальной эксплуатации анализатора:

- электролит ЭК;
- узел мембранный М404;
- кольцо 011-014-19-2-7;
- шприц.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 В случае обнаружения некомплектности при получении анализатора потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

Телефон/факс: (831) 282-98-00
Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

12.2 В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

Телефон/факс: (831) 282-98-02
Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

12.3 Рекламация предъявляется письменно с указанием некомплектности или неисправности.

13 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

В конструкции каждого из датчиков кислородных анализатора использованы драгоценные металлы:

- серебро – проволока Ср 99,99 Т 0,5 ГОСТ 7222-2014 – 320 мг;
- платина – проволока Пл 99,93 Т 1,0 П ГОСТ 18389-2014 – 150 мг.

14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

14.1 Транспортирование анализаторов в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом железнодорожном или автомобильном транспорте в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 20 до плюс 50 °С.

14.2 Хранение анализаторов в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ
ФБУ «Нижегородский ЦСМ»



И.И. Решетник

2011 г.

АНАЛИЗАТОР РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА
МАРК-404


Методика поверки

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «ВЗОР»

 Е.В. Киселев

Гл. конструктор ООО «ВЗОР»

 А. К. Родионов

г. Нижний Новгород
2011 г.

А.1 Область применения

Настоящая методика распространяется на анализатор растворенного кислорода МАРК-404, предназначенные для измерения массовой концентрации растворенного в воде кислорода (КРК) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал один год.

А.2 Используемые нормативные документы

Р 50.2.045-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика поверки».

РМГ 51-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

А.3 Метрологические характеристики, проверяемые при поверке

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК при температуре анализируемой среды $(20,0 \pm 0,2) \text{ } ^\circ\text{C}$ и температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) \text{ } ^\circ\text{C}$ должны быть, мг/дм³..... $\pm (0,05 + 0,04C)$,

где C – здесь и далее по тексту – измеряемое значение КРК (или соответствующее ему значение тока).

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализатора при преобразовании КРК в выходной ток анализатора при температуре анализируемой среды $(20,0 \pm 0,2) \text{ } ^\circ\text{C}$ и температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) \text{ } ^\circ\text{C}$ должны быть, мА $\pm (0,05 + 0,035I_{\text{вых}})$.

А.4 Операции поверки

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице А.4.1.

Таблица А.4.1

| Наименование операции | Номера пп. методики | Необходимость проведения операции при | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | первичной поверке | периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | | + | + |
| 2 Опробование | | + | + |
| 3 Проверка «нуля» анализатора | | + | + |
| 4 Определение основной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК | | + | + |
| 5 Определение основной абсолютной погрешности преобразования измеренного значения КРК в выходной ток анализатора | | + | + |
| <u>Примечание</u> – Знак «+» означает, что операцию проводят. | | | |

А.5 Средства поверки

Средства измерения, реактивы, материалы, применяемые при поверке, указаны в таблице А.5.1.

Таблица А.5.1

| Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки | Номер пункта методики поверки |
|---|-------------------------------|
| Гигрометр психрометрический типа ВИТ-1 Диапазон измерения относительной влажности воздуха от 20 до 90 %. Абсолютная погрешность измерения $\pm 7\%$. | А.8 |
| Барометр-анероид БАММ-1 ТУ-25-04-15-13-79; диапазон измеряемого давления от 80 до 106 кПа, предел допускаемой основной абсолютной погрешности $\pm 0,2$ кПа | А.8 А.10.4 |

Продолжение таблицы А.5.1

| Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки | Номер пункта методики поверки |
|---|-------------------------------|
| Мультиметр цифровой АРРА-305 Используемый предел измерения переменного напряжения 400 В; основная абсолютная погрешность измерения, В: $\pm (0,007X + 0,05)$, где X – измеренное, значение переменного напряжения, В. Используемый предел измерения силы постоянного тока 40 мА; основная абсолютная погрешность измерения, мА: $\pm (0,002X + 0,004)$, где X – измеренное значение силы постоянного тока, мА | А.8 |
| Кислородно-азотные поверочные газовые смеси (ПГС) ТУ-16-2956-2001 ГСО 3722-87, объемная доля кислорода от 2,50 до 3,93 %; ГСО 3726-87 объемная доля кислорода от 10,4 до 12,3 % | А.10.4 |
| Термометр лабораторный электронный ЛТ-300 ТУ 4211-041-44229117-2005 Диапазон измерения от минус 50 до плюс 300 °С, погрешность измерения $\pm 0,05$ °С | А.10.4 |
| Секундомер механический СОСпр-26-2-000 ТУ 25-1894.003-90 | А.10.3 |
| Термостат жидкостный ТЖ-ТС-01/26 Диапазон регулирования температуры от 10 до 100 °С. Погрешность поддержания температуры не более $\pm 0,1$ °С. | А.10.4 |
| Ротаметр РМ-А 0,063 ГУЗ ГОСТ 13045-81 | А.10.4 |
| Микрокомпрессор АЭН-4 ГОСТ 14087-80 | А.10.4 |
| Стакан цилиндрический СЦ-5 ГОСТ 23932-79Е | А.10.3 |
| Посуда мерная лабораторная стеклянная ГОСТ 1770-74 | А.10.3 |
| Натрий сернистокислый, ч.д.а. ГОСТ 195-77 | А.10.3 |
| Кобальт хлористый 6-водный ч.д.а. ГОСТ 4525-77 | А.10.3 |
| Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | А.10.3 А.10.4 |
| Трубка медицинская поливинилхлоридная ПМ-1/42 Ø16×2, L=60 мм | А.10.4 |

Примечания

1 Допускается применение других средств измерения, не приведенных в перечне, но обеспечивающих определение метрологических характеристик с необходимой точностью.

2 Для измерения температуры допускается применение других средств измерения с погрешностью измерения не хуже $\pm 0,1$ °С.

А.6 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки анализаторов допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей в области измерения физико-химического состава и свойств веществ, имеющие высшее или среднетехническое образование, опыт работы в химических лабораториях не менее года, владеющие техникой потенциметрических и амперометрических измерений и изучившие настоящую методику поверки.

А.7 Требования безопасности

При проведении поверки должны соблюдаться требования техники безопасности:

– при работе с химическими реактивами – по ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.4.021-75;

– при работе с электроустановками – по ГОСТ Р 12.1.019-2009 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

Должны соблюдаться также правила работы с баллонами с ПГС под давлением.

Помещение, в котором осуществляется поверка, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

Исполнители должны быть проинструктированы о мерах безопасности, которые должны соблюдаться при работе с приборами, в соответствии с РЭ. Обучение поверителей правилам безопасности труда должно проводиться по ГОСТ 12.0.004-90.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа с анализатором при снятых крышках корпуса блока преобразовательного!

А.8 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С (20 ± 5);
- относительная влажность воздуха, %, не более 80;
- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7;
- поверочные газовые смеси должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 10 ч.

Измерительные приборы, нестандартное оборудование должны иметь отметки, подтверждающие их годность.

А.9 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки подготавливают к работе анализатор в соответствии с разделом 2.3 руководства по эксплуатации ВР16.00.000РЭ и проводят проверку технического состояния анализатора в соответствии с разделом 2.4 Руководства по эксплуатации ВР16.00.000РЭ.

Измерительные приборы, нестандартное оборудование должны иметь отметки, подтверждающие их годность, и подготовлены к работе в соответствии с требованиями их технической документации.

А.10 Проведение поверки

А.10.1 Внешний осмотр

Анализатор должен быть представлен на поверку с руководством по эксплуатации, совмещенным с паспортом (ВР16.00.000РЭ).

У анализатора проверяют:

- исправность разъемов, кнопок, соединительных кабелей;
- состояние лакокрасочных покрытий, правильность и четкость маркировки.

Анализаторы, имеющие дефекты, затрудняющие эксплуатацию, к дальнейшей поверке не допускают.

А.10.2 Опробование

А.10.2.1 Проверка функционирования анализатора

Подключают блок преобразовательный к сети. Датчики кислородные размещают на воздухе.

Проверяют работоспособность кнопок « \Leftarrow », « \Rightarrow ».

Результаты проверки считают удовлетворительными, если при каждом нажатии любой из кнопок происходит поочередное переключение каналов измерения анализатора, при этом загорается соответствующий включенному каналу светодиодный индикатор.

А.10.2.2 Проверка соответствия ПО

Для просмотра версии ПО переходят в соответствии с п. 1.5.4.1 РЭ к экрану индикации номера версии ПО («02.00»).

Переходят в служебное меню (доступ к служебному МЕНЮ передается представителям уполномоченных органов по их запросу) и проверяют контрольную сумму исполняемого кода. Она должна соответствовать значению «0x9C49».

Проверяют обеспечение защиты ПО от несанкционированного доступа (проверяют наличие пломбирования крепления защитной крышки платы блока преобразовательного).

Приборы, результаты опробования которых не соответствуют приведенным требованиям, бракуют и к дальнейшей поверке не допускают.

А.10.3 Проверка «нуля» анализатора

А.10.3.1 Подготовка к измерениям

Приготавливают раствор натрия сернистокислого натрия Na_2SO_3 концентрации 50 г/дм^3 («нулевой» раствор) и раствор кобальта хлористого б-водного концентрацией 2 г/дм^3 .

В сосуд емкостью 0,3-0,5 дм³ наливают раствор Na₂SO₃ таким образом, чтобы высота жидкости была в диапазоне от 50 до 70 мм, и отстаивают не менее часа. Для ускорения процесса деоксирования раствора добавить 5 см³ раствора кобальта хлористого 6-водного.

А.10.3.2 Выполнение измерений

Включают анализатор.

Погружают датчик в «нулевой» раствор, одновременно включают секундомер.

Фиксируют показания анализатора $C_{\text{нуль}10}$, мг/дм³, через 10 мин.

А.10.3.3 Обработка результатов измерений

Результаты проверки нуля анализатора считают удовлетворительными, если показания через 10 мин после погружения датчика в «нулевой» раствор $C_{\text{нуль}10}$, мг/дм³, находятся в пределах

$$-0,050 \leq C_{\text{нуль}10} \leq 0,050.$$

А.10.4 Определение основной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК.

В соответствии с ГОСТ 22729-84 основную абсолютную погрешность анализатора при измерении КРК определяют в трех точках диапазона измерения, расположенных на начальном (0-20 % от диапазона), среднем (45-55 % от диапазона) и конечном (80-100 % от диапазона) участках диапазона измерений. Для проверки используются дистиллированная вода с удельной электрической проводимостью не более 5 мкСм/см, насыщенная кислородом воздуха, а также кислородно-азотные поверочные газовые смеси (ПГС).

Концентрации кислорода в ПГС и в воздухе, концентрации растворенного кислорода, создаваемые этими ПГС и воздухом, приведены в таблице А.10.1.

Таблица А.10.1

| № точки | Параметры кислородно-азотной поверочной газовой смеси (ПГС), воздуха | Массовая концентрация кислорода при $t=20\text{ }^{\circ}\text{C}$, мг/дм ³ | Участок диапазона измерения, % от диапазона |
|---------|--|---|---|
| 1 | ГСО 3722-87 с объемной долей кислорода 2,50-3,93 % (№ 1) | 1,1-1,70 | 0-20 |
| 2 | ГСО 3726-87 с объемной долей кислорода 10,4-12,3 % (№ 2) | 4,5-5,5 | 45-55 |
| 3 | Воздух 100 % влажности, с объемной долей кислорода 20,95 % | 9,09 | 80-100 |

А.10.4.1 Определение погрешностей анализатора в точке № 3

Для проверки погрешности в указанной точке используют дистиллированную воду, насыщенную атмосферным воздухом, с концентрацией кислорода, соответствующей 100 % насыщения.

А.10.4.1.1 Подготовка к измерениям

Собирают установку в соответствии с рисунком А.10.1.

К каналу № 1 блока преобразовательного подключают датчик кислородный. Включают режим индикации канала № 1.

К каналу № 1 токового выхода (контактам 1, 9 розетки DB15-F (с/к) в соответствии с таблицей А.10.2) подсоединяют мультиметр АРРА-305, включенный в режиме измерения постоянного тока на диапазоне 0-40 мА.

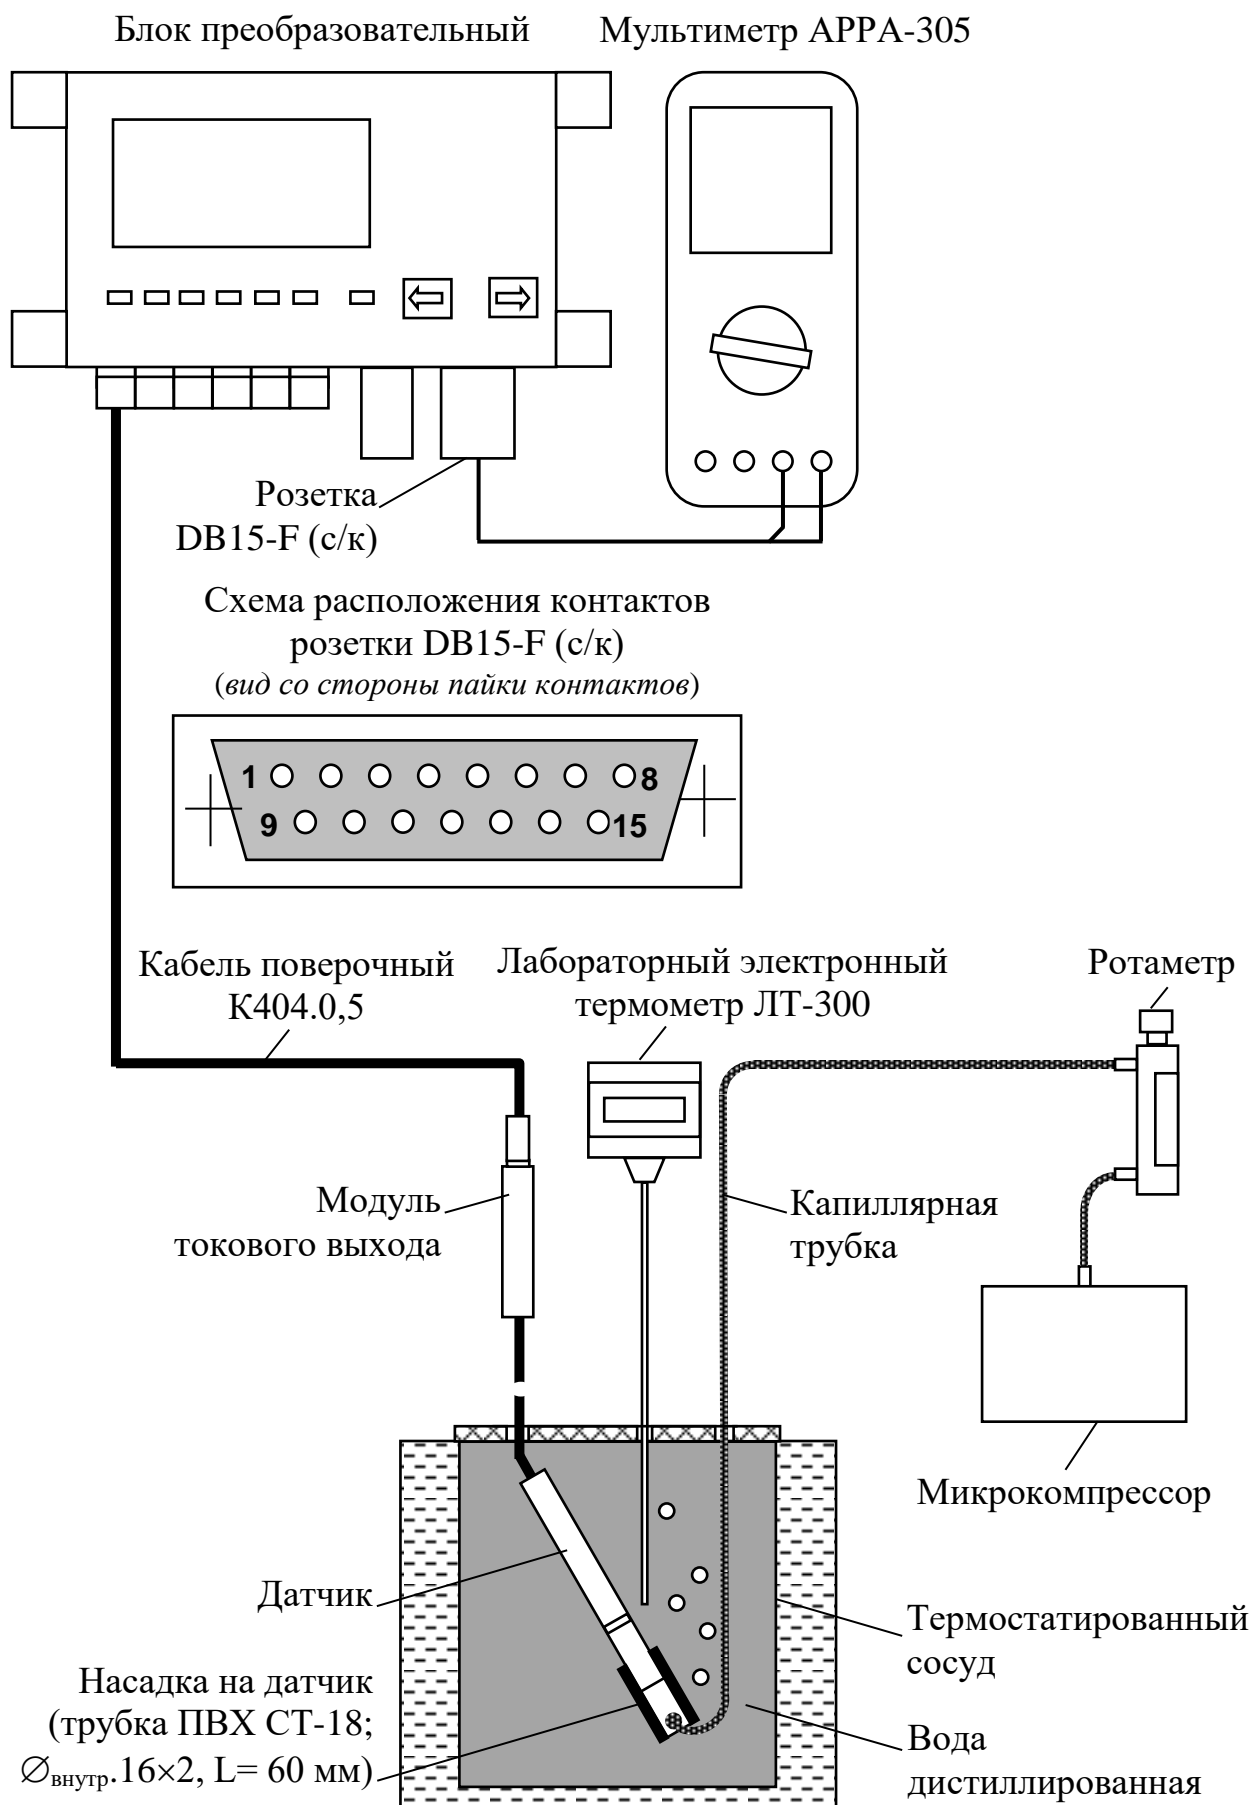


Рисунок А.10.1

Таблица А.10.2

| № канала | № контакта | Цепь | № канала | № контакта | Цепь |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 | 1 | $I_{вых}$ | 4 | 4 | $I_{вых}$ |
| | 9 | Корпус | | 12 | Корпус |
| 2 | 2 | $I_{вых}$ | 5 | 5 | $I_{вых}$ |
| | 10 | Корпус | | 13 | Корпус |
| 3 | 3 | $I_{вых}$ | 6 | 6 | $I_{вых}$ |
| | 11 | Корпус | | 14 | Корпус |

В термостатированный сосуд заливают дистиллированную воду.

В сосуде устанавливают:

- датчик, который должен быть расположен в сосуде под углом 60-70° к горизонтальной поверхности;
- эталонный термометр;
- изогнутую капиллярную трубку, соединенную с выходом микрокомпрессора.

Включают микрокомпрессор и термостат.

С помощью термостата доводят температуру воды в сосуде до значения $(20,0 \pm 0,2)$ °С и поддерживают ее с точностью $\pm 0,1$ °С.

С помощью капиллярной трубки подводят к мембране датчика воздух от компрессора. Ротаметром устанавливают такую скорость подачи воздуха, чтобы каждые 3-5 с обновлялся воздушный пузырь внутри колпака.

Через 10 мин, не извлекая датчик из сосуда с водой, проводят операции градуировки анализатора по кислороду воздуха.

Для этого шлицом переменного резистора, расположенным на торцевой поверхности модуля токового выхода, устанавливают показания блока преобразовательного, равные

$$C_{град} = Co_2(t) \cdot \frac{P_{атм}}{101,325}, \quad (A.10.1)$$

где $Co_2(t)$ – значение КРК для температуры 20 °С, взятое из таблицы Б.1, и равное 9,09 мг/дм³;

$P_{атм}$ – атмосферное давление на момент градуировки, кПа.

А.10.4.1.2 Выполнение измерений

Фиксируют атмосферное давление $P_{атм}$, кПа, по барометру.

Убирают капиллярную трубку от мембраны датчика на 2-3 мин, затем снова подводят воздух к мембране.

Через 2 мин фиксируют показания анализатора C , мг/дм³, и показания мультиметра $\Delta I_{\text{вых}}^{0-20}$, мА, или $\Delta I_{\text{вых}}^{4-20}$, мА.

Повторяют измерения еще два раза, каждый раз предварительно подводя к мембране датчика воздух от компрессора.

А.10.4.1.3 Обработка результатов

Рассчитывают основную абсолютную погрешность анализатора при измерении КРК ΔC , мг/дм³, для всех трех измерений по формуле:

$$\Delta C = C - \frac{P_{\text{атм}}}{101,325} \cdot Co_{2\text{возд}}(20), \quad (\text{А.10.2})$$

где $Co_{2\text{возд}}(20)$ – растворимость кислорода воздуха в воде при температуре 20 °С, взятая из приложения Б и равная 9,09 мг/дм³.

Рассчитывают основную абсолютную погрешность преобразования КРК в выходной ток анализатора для токового выхода 0-20 мА $\Delta I_{\text{вых}}^{0-20}$, мА, для всех трех измерений по формуле:

$$\Delta I_{\text{вых}}^{0-20} = I_{\text{вых}}^{0-20} - \beta \cdot \frac{P_{\text{атм}}}{101,325} \cdot Co_{2\text{возд}}(20); \quad (\text{А.10.3})$$

или для токового выхода 4-20 мА $\Delta I_{\text{вых}}^{4-20}$, мА, для всех трех измерений по формуле:

$$\Delta I_{\text{вых}}^{4-20} = I_{\text{вых}}^{4-20} - \left(4 + 16 \cdot \frac{\beta \cdot \frac{P_{\text{атм}}}{101,325} \cdot Co_{2\text{возд}}(20)}{20} \right), \quad (\text{А.10.4})$$

где $\beta = 1 \frac{\text{мА}}{\text{мг/дм}^3}$ в отградуированном датчике кислородном.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если для всех трех измерений выполняются условия:

$$\begin{aligned} -(0,05+0,04C) &\leq \Delta C \leq 0,05+0,04C; \\ -(0,05+0,035 I_{\text{вых}}^{0-20}) &\leq \Delta I_{\text{вых}}^{0-20} \leq 0,05+0,035 I_{\text{вых}}^{0-20}; \\ -(0,05+0,035 I_{\text{вых}}^{4-20}) &\leq \Delta I_{\text{вых}}^{4-20} \leq 0,05+0,035 I_{\text{вых}}^{4-20}. \end{aligned}$$

Аналогичным образом проводят поверку остальных датчиков кислородных, входящих в комплект анализатора.

А.10.4.2 Определение погрешностей анализатора в точке № 2

Для проверки погрешностей в указанной точке используют ПГС № 2 (в соответствии с таблицей А.10.1).

А.10.4.2.1 Подготовка к измерениям

Собирают установку в соответствии с рисунком А.10.2.

Подготовка к измерениям аналогична п. А.10.4.1.1, но вместо воздуха от компрессора к мембране датчика подают ПГС.

При закрытом редукторе открывают вентиль баллона с ПГС.

Плавно открывая вентиль редуктора, подводят ПГС с помощью капиллярной трубки к мембране датчика.

Скорость подачи ПГС должна быть такой, чтобы каждые 3-5 с обновлялся воздушный пузырь внутри насадки на датчик.

А.10.4.2.2 Выполнение измерений

Фиксируют атмосферное давление $P_{атм}$, кПа, по барометру.

Убирают капиллярную трубку от мембраны датчика на 2-3 мин, затем снова подводят ПГС к мембране.

Через 2 мин фиксируют показания анализатора C , мг/дм³, и показания вольтметра $\Delta I_{вых}^{0-20}$, мА, или $\Delta I_{вых}^{4-20}$, мА.

Повторяют измерения еще два раза, каждый раз предварительно подводя к мембране датчика ПГС от баллона.

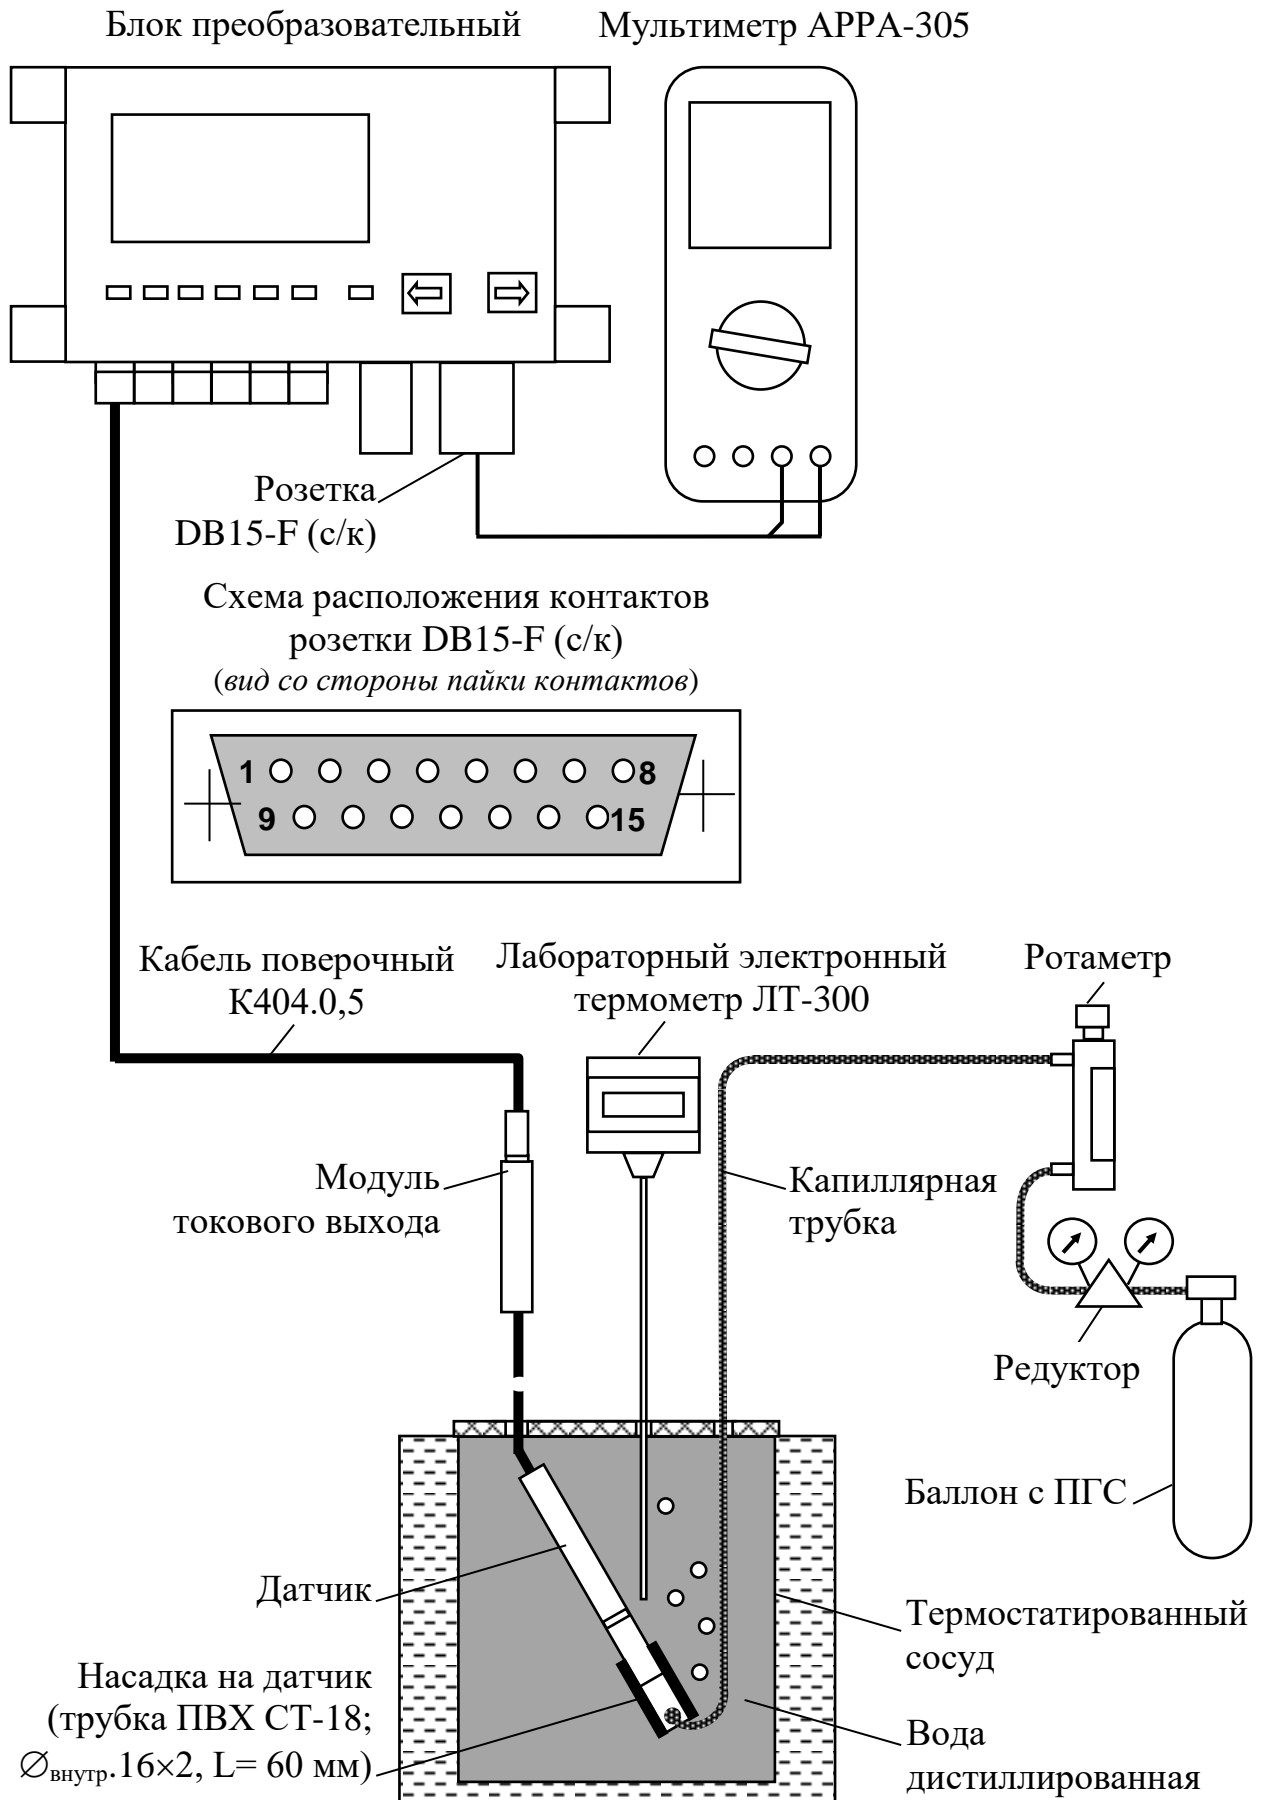


Рисунок А.10.2

А.10.4.2.3 Обработка результатов

Рассчитывают основную абсолютную погрешность анализатора при измерении КРК ΔC , мг/дм³, для всех трех измерений по формуле:

$$\Delta C = C - \frac{P_0}{20,95} \cdot \frac{P_{атм}}{101,325} \cdot Co_{2возд}(20), \quad (\text{А.10.5})$$

где P_0 – объемная доля кислорода в ПГС, %;

$Co_{2возд}(20)$ – растворимость кислорода воздуха в воде при температуре 20 °С, взятая из приложения Б и равная 9,09 мг/дм³.

Рассчитывают основную абсолютную погрешность преобразования КРК в выходной ток анализатора для токового выхода 0-20 мА $\Delta I_{вых}^{0-20}$, мА, для всех трех измерений по формуле:

$$\Delta I_{вых}^{0-20} = I_{вых}^{0-20} - \beta \cdot \frac{P_0}{20,95} \cdot \frac{P_{атм}}{101,325} \cdot Co_{2возд}(20); \quad (\text{А.10.6})$$

или для токового выхода 4-20 мА $\Delta I_{вых}^{4-20}$, мА, для всех трех измерений по формуле:

$$\Delta I_{вых}^{4-20} = I_{вых}^{4-20} - \left(4 + 16 \cdot \frac{\beta \cdot \frac{P_0}{20,95} \cdot \frac{P_{атм}}{101,325} \cdot Co_{2возд}(20)}{20} \right), \quad (\text{А.10.7})$$

где $\beta = 1 \frac{\text{мА}}{\text{мг/дм}^3}$ в отградуированном датчике кислородном.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если для всех трех измерений выполняются условия:

$$-(0,05+0,04C) \leq \Delta C \leq 0,05+0,04C;$$

$$-(0,05+0,035 I_{вых}^{0-20}) \leq \Delta I_{вых}^{0-20} \leq 0,05+0,035 I_{вых}^{0-20};$$

$$-(0,05+0,035 I_{вых}^{4-20}) \leq \Delta I_{вых}^{4-20} \leq 0,05+0,035 I_{вых}^{4-20}.$$

Аналогичным образом проводят поверку остальных датчиков кислородных, входящих в комплект анализатора.

А.10.4.3 Определение погрешностей анализатора в точке № 1

Для проверки погрешности в указанной точке используют ПГС № 1 (в соответствии с таблицей А.10.1).

Установка, подготовка к измерениям, проведение измерений и обработка результатов аналогичны указанным в п. А.10.4.2.

А.11 Оформление результатов поверки

А.11.1 Результаты поверки считают положительными, если анализатор МАРК-404 удовлетворяет требованиям настоящей методики.

А.11.2 При проведении поверки анализатора составляют протокол, в котором указывается его соответствие предъявляемым требованиям.

А.11.3 Положительные результаты поверки оформляют выдачей свидетельства о поверке.

А.11.4 Результаты считают отрицательными, если при проведении поверки установлено несоответствие проверяемого анализатора МАРК-404 хотя бы одному из требований настоящей методики.

А.11.5 Отрицательные результаты поверки оформляются путем выдачи извещения о непригодности анализатора.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б*(справочное)*

РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОРОДА ВОЗДУХА 100 % ВЛАЖНОСТИ
В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

$P_{атм}=101,325$ кПа

Таблица Б.1

мг/дм³

| t, °C | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 14,62 | 14,58 | 14,54 | 14,50 | 14,46 | 14,42 | 14,38 | 14,34 | 14,30 | 14,26 |
| 1 | 14,22 | 14,18 | 14,14 | 14,10 | 14,06 | 14,02 | 13,98 | 13,94 | 13,90 | 13,87 |
| 2 | 13,83 | 13,79 | 13,75 | 13,72 | 13,68 | 13,64 | 13,60 | 13,57 | 13,53 | 13,49 |
| 3 | 13,46 | 13,42 | 13,39 | 13,35 | 13,32 | 13,28 | 13,24 | 13,21 | 13,17 | 13,14 |
| 4 | 13,11 | 13,07 | 13,04 | 13,00 | 12,97 | 12,93 | 12,90 | 12,87 | 12,83 | 12,80 |
| 5 | 12,77 | 12,74 | 12,70 | 12,67 | 12,64 | 12,61 | 12,57 | 12,54 | 12,51 | 12,48 |
| 6 | 12,45 | 12,41 | 12,38 | 12,35 | 12,32 | 12,29 | 12,26 | 12,23 | 12,20 | 12,17 |
| 7 | 12,14 | 12,11 | 12,08 | 12,05 | 12,02 | 11,99 | 11,96 | 11,93 | 11,90 | 11,87 |
| 8 | 11,84 | 11,81 | 11,79 | 11,76 | 11,73 | 11,70 | 11,67 | 11,64 | 11,62 | 11,59 |
| 9 | 11,56 | 11,53 | 11,51 | 11,48 | 11,45 | 11,42 | 11,40 | 11,37 | 11,34 | 11,32 |
| 10 | 11,29 | 11,26 | 11,24 | 11,21 | 11,18 | 11,16 | 11,13 | 11,11 | 11,08 | 11,06 |
| 11 | 11,03 | 11,00 | 10,98 | 10,95 | 10,93 | 10,90 | 10,88 | 10,85 | 10,83 | 10,81 |
| 12 | 10,78 | 10,76 | 10,73 | 10,71 | 10,68 | 10,66 | 10,64 | 10,61 | 10,59 | 10,56 |
| 13 | 10,54 | 10,52 | 10,49 | 10,47 | 10,45 | 10,42 | 10,40 | 10,38 | 10,36 | 10,33 |
| 14 | 10,31 | 10,29 | 10,27 | 10,24 | 10,22 | 10,20 | 10,18 | 10,15 | 10,13 | 10,11 |
| 15 | 10,08 | 10,06 | 10,04 | 10,02 | 10,00 | 9,98 | 9,96 | 9,94 | 9,92 | 9,90 |
| 16 | 9,87 | 9,85 | 9,83 | 9,81 | 9,79 | 9,77 | 9,75 | 9,73 | 9,71 | 9,69 |
| 17 | 9,66 | 9,64 | 9,62 | 9,60 | 9,58 | 9,56 | 9,54 | 9,52 | 9,50 | 9,49 |
| 18 | 9,47 | 9,45 | 9,43 | 9,41 | 9,39 | 9,37 | 9,36 | 9,34 | 9,32 | 9,30 |
| 19 | 9,28 | 9,26 | 9,24 | 9,22 | 9,21 | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,13 | 9,11 |
| 20 | 9,09 | 9,08 | 9,06 | 9,04 | 9,02 | 9,01 | 8,99 | 8,97 | 8,95 | 8,93 |
| 21 | 8,91 | 8,89 | 8,87 | 8,86 | 8,85 | 8,83 | 8,81 | 8,80 | 8,78 | 8,76 |
| 22 | 8,74 | 8,73 | 8,71 | 8,69 | 8,68 | 8,66 | 8,64 | 8,63 | 8,61 | 8,60 |
| 23 | 8,58 | 8,56 | 8,55 | 8,53 | 8,51 | 8,50 | 8,48 | 8,47 | 8,45 | 8,43 |
| 24 | 8,42 | 8,40 | 8,39 | 8,37 | 8,36 | 8,34 | 8,32 | 8,31 | 8,29 | 8,28 |
| 25 | 8,26 | 8,25 | 8,23 | 8,22 | 8,20 | 8,19 | 8,17 | 8,16 | 8,14 | 8,13 |
| 26 | 8,11 | 8,10 | 8,08 | 8,07 | 8,05 | 8,04 | 8,02 | 8,01 | 7,99 | 7,98 |
| 27 | 7,97 | 7,95 | 7,94 | 7,92 | 7,91 | 7,89 | 7,88 | 7,87 | 7,85 | 7,84 |
| 28 | 7,83 | 7,81 | 7,80 | 7,78 | 7,77 | 7,76 | 7,74 | 7,73 | 7,71 | 7,70 |
| 29 | 7,69 | 7,67 | 7,66 | 7,65 | 7,63 | 7,62 | 7,61 | 7,59 | 7,58 | 7,57 |

Продолжение таблицы Б.1

| t, °C | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30 | 7,56 | 7,54 | 7,53 | 7,52 | 7,50 | 7,49 | 7,48 | 7,46 | 7,45 | 7,44 |
| 31 | 7,44 | 7,44 | 7,43 | 7,42 | 7,41 | 7,39 | 7,38 | 7,37 | 7,36 | 7,35 |
| 32 | 7,33 | 7,32 | 7,31 | 7,30 | 7,29 | 7,28 | 7,26 | 7,25 | 7,24 | 7,23 |
| 33 | 7,22 | 7,21 | 7,19 | 7,18 | 7,17 | 7,16 | 7,15 | 7,14 | 7,13 | 7,11 |
| 34 | 7,10 | 7,09 | 7,08 | 7,07 | 7,06 | 7,05 | 7,04 | 7,03 | 7,01 | 7,00 |
| 35 | 6,99 | 6,98 | 6,97 | 6,96 | 6,95 | 6,94 | 6,93 | 6,92 | 6,90 | 6,89 |
| 36 | 6,82 | 6,81 | 6,80 | 6,78 | 6,77 | 6,76 | 6,75 | 6,74 | 6,73 | 6,72 |
| 37 | 6,71 | 6,70 | 6,69 | 6,68 | 6,67 | 6,66 | 6,65 | 6,64 | 6,63 | 6,62 |
| 38 | 6,61 | 6,60 | 6,59 | 6,58 | 6,57 | 6,56 | 6,55 | 6,54 | 6,53 | 6,52 |
| 39 | 6,51 | 6,50 | 6,49 | 6,48 | 6,47 | 6,46 | 6,45 | 6,44 | 6,43 | 6,42 |
| 40 | 6,41 | 6,40 | 6,39 | 6,38 | 6,37 | 6,36 | 6,35 | 6,34 | 6,33 | 6,32 |
| 41 | 6,31 | 6,30 | 6,29 | 6,28 | 6,27 | 6,26 | 6,25 | 6,24 | 6,23 | 6,22 |
| 42 | 6,21 | 6,20 | 6,19 | 6,19 | 6,18 | 6,17 | 6,16 | 6,15 | 6,14 | 6,13 |
| 43 | 6,12 | 6,11 | 6,10 | 6,09 | 6,08 | 6,07 | 6,06 | 6,05 | 6,04 | 6,04 |
| 44 | 6,03 | 6,02 | 6,01 | 6,00 | 5,99 | 5,98 | 5,97 | 5,96 | 5,95 | 5,94 |
| 45 | 5,93 | 5,92 | 5,92 | 5,91 | 5,90 | 5,89 | 5,88 | 5,87 | 5,86 | 5,85 |
| 46 | 5,84 | 5,83 | 5,82 | 5,82 | 5,81 | 5,80 | 5,79 | 5,78 | 5,77 | 5,76 |
| 47 | 5,75 | 5,74 | 5,74 | 5,73 | 5,72 | 5,71 | 5,70 | 5,69 | 5,68 | 5,67 |
| 48 | 5,66 | 5,66 | 5,65 | 5,64 | 5,63 | 5,62 | 5,61 | 5,60 | 5,59 | 5,59 |
| 49 | 5,58 | 5,57 | 5,56 | 5,55 | 5,54 | 5,53 | 5,52 | 5,52 | 5,51 | 5,50 |
| 50 | 5,49 | 5,48 | 5,47 | 5,47 | 5,46 | 5,45 | 5,44 | 5,44 | 5,43 | 5,42 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

В приборе реализована функция 04 – Read Input Registers протокола MODBUS в режиме RTU.

Для чтения доступно указанное ниже адресное пространство прибора (адрес формируется как адрес двух байтового регистра, таким образом указанные адреса в двое меньше физического адреса памяти процессора MSP430 прибора).

Таблица В.1 – Измеренные значения прибора МАРК-404

| Группа | Имя | Адрес (HEX) | Формат |
|--|---|-------------|------------------------------|
| Измеренное значение тока, мА | Измеренное значение тока канала 1 | 0x0100 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение тока канала 2 | 0x0102 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение тока канала 3 | 0x0104 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение тока канала 4 | 0x0106 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение тока канала 5 | 0x0108 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение тока канала 6 | 0x010A | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение тока канала градуировки | 0x010C | Float (4 байта) (2 регистра) |
| Измеренное значение КРК, мкг/дм ³ | Измеренное значение КРК канала 1 | 0x010E | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение КРК канала 2 | 0x0110 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение КРК канала 3 | 0x0112 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение КРК канала 4 | 0x0114 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение КРК канала 5 | 0x0116 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение КРК канала 6 | 0x0118 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Измеренное значение КРК канала градуировки | 0x011A | Float (4 байта) (2 регистра) |
| Среднее значение КРК, мкг/дм ³ | Среднее значение КРК канала 1 | 0x011C | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Среднее значение КРК канала 2 | 0x011E | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Среднее значение КРК канала 3 | 0x0120 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Среднее значение КРК канала 4 | 0x0122 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Среднее значение КРК канала 5 | 0x0124 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| | Среднее значение КРК канала 6 | 0x0126 | Float (4 байта) (2 регистра) |
| Ошибка | ErrorI0 | 0x0128 | Word (2 байта) (1 регистр) |
| | ErrorI4+ErrorI5 | 0x0129 | Word (2 байта) (1 регистр) |
| | ErrorI30 | 0x012A | Word (2 байта) (1 регистр) |
| | Тип токового выхода канала градуировки | 0x012B | Word (2 байта) (1 регистр) |
| | Вычисленное значение контрольной суммы кода программы | 0x012C | Word (2 байта) (1 регистр) |

Таблица В.2 – Параметры прибора

| Группа | Имя | Адрес (HEX) | Формат |
|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|
| Тип токового выхода | Тип токового выхода канала 1 | 0x0840 | Word (2 байта) (1 регистр) |
| | Тип токового выхода канала 2 | 0x0841 | Word (2 байта) (1 регистр) |
| | Тип токового выхода канала 3 | 0x0842 | Word (2 байта) (1 регистр) |
| | Тип токового выхода канала 4 | 0x0843 | Word (2 байта) (1 регистр) |
| | Тип токового выхода канала 5 | 0x0844 | Word (2 байта) (1 регистр) |
| | Тип токового выхода канала 6 | 0x0845 | Word (2 байта) (1 регистр) |
| | Не определено | 0x0846 | Word (2 байта) (1 регистр) |
| Время усреднения, мин | Время усреднения | 0x0847 | Word (2 байта) (1 регистр) |

Таблица В.3 – Наименование анализатора

| Группа | Имя | Адрес (HEX) | Формат |
|--------------|---|-------------|-------------------|
| Наименование | Строка комплексного наименования прибора и программного обеспечения | 0x0880 | String (105 байт) |

Таблица В.4 – Идентификатор ПО анализатора

| Группа | Имя | Адрес (HEX) | Формат |
|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Идентификатор ПО | Строка идентификатора ПО | 0x0A00 | String (16 байт) |
| КС | Значение контрольной суммы | 0x0A08 | Word (2 байта) (1 регистр) |

Адреса записаны в шестнадцатеричном виде.

ErrorI0 – измеренное значение тока в канале имеет отрицательное значение.

ErrorI4 – измеренное значение тока в канале <4 мА при типе токового выхода (4-20 мА).

ErrorI30 – измеренное значение тока в канале >30 мА.

Error15 – напряжение питания датчиков вне диапазона 12-18 В.

Наличие ошибки – 1, отсутствие ошибки – 0.

ErrorI4 – адрес 0X129

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e15 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Bit 15

Bit 0

ch1 ...ch6 – состояние ошибки ErrorI4 в каналах 1...6.

ch7 – состояние ошибки ErrorI4 в канале градуировки.

e15 – состояние ошибки Error15.

ErrorI0, ErrorI30 – адрес 0X128, 0X12A

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Bit 15

Bit 0

ch1 ...ch6 – состояние ошибки в каналах 1 ... 6.

ch7 – состояние ошибки в канале градуировки.

Тип токового выхода – адрес 0X12B, 0X0840 ... 0X0846

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bit 15

Bit 0

XX = 00 – тип токового выхода (4-20 мА).

XX = 01 – тип токового выхода (0-20 мА).

XX = 02 – и любое другое – (канал отключен)

Время усреднения – адрес 0X0847

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bit 15

Bit 0

XXXX = время усреднения в минутах (0-9).

Измеренное значение

Числа float измеренных значений расположены в двух последовательных регистрах.

Младшая часть расположена в регистре с меньшим адресом.

ВНИМАНИЕ: В соответствии с протоколом MODBUS данные 16-ти разрядного регистра передаются двумя байтами старшим байтом вперед!

Вычисленное значение контрольной суммы кода программы – адрес 0x012C.

Шестнадцатиразрядное число, полученное путем арифметического сложения шестнадцатиразрядных регистров по всей памяти программ, в том числе блока режимов работы прибора. Вычисление производится при включении анализатора и обновляется после каждой команды чтения данного адреса.

Наименование прибора – адрес 0X0880.

Строка текста с разделителем <tab>.

Пример:

y<tab>000001<tab>15.03.10<tab>404P_430_02_00.txt<tab> Программное
обеспечение анализатора растворенного кислорода МАРК-404.

Идентификатор ПО прибора – адрес 0x0A00.

Строка текста МАРК-404 v02.XX.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОЛИТЕ

Г.1 Сведения об электролите приведены в таблице Г.1.

Таблица Г.1

| Наименование и обозначение | Электролит ЭК ВР47.05.100 |
|---|---|
| Внешний вид | бесцветная жидкость |
| Состав и информация о компонентах | водный раствор. Состав: KCL, хч – 14 г; KOH, х.ч. – 0,2 г; трилон Б – 0,15 г; вода дистиллированная до 0,1дм ³ |
| Растворимость в воде | растворимый |
| Токсичность | не токсичен |
| pH при 20 °С | 12,4 |
| Транспортировка | все виды транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта |
| Утилизация | утилизируется как химический реактив |
| Хранение: – условия и место хранения – температура хранения | хранить в закрытой таре в крытых складских помещениях в условиях, установленных для хранения щелочей; от минус 30 до плюс 50 °С. |
| Срок годности | не ограничен |
| Меры предосторожности | работать в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной механической вентиляцией с соблюдением техники безопасности по ГОСТ 12.1.007-76. |
| Индивидуальные средства защиты | защитные перчатки, очки или маска |
| Первая помощь: – при отравлении пероральным путем (попадании в рот) – при попадании в глаза – при контакте с кожей | промыть рот и зев обильным количеством воды промыть 2 %-ным водным раствором борной кислоты; обратиться к врачу. смыть обильным количеством воды или 2 %-ным водным раствором борной кислоты. |

ЗАКАЗАТЬ